



ใบรับรองปัญหาพิเศษ

เรื่อง

การออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใสเพื่อ
การวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง

(Design of Transparent Liquid Food Holder for Color Measurement Using
Reflection Colorimeter)

จัดทำโดย

นางสาวโชติกา	อ้วนแสง	รหัสนักศึกษา 47040870
นางสาวนาตยา	สุรปภา	รหัสนักศึกษา 47040876
นางสาววัชรภรณ์	อดิเทพสถิต	รหัสนักศึกษา 47040887

ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก

..... 20 / ส. ก. / 2551

(ดร.กิตติชัย บรรจง)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

นางสาวโชติกา อ้วนแสง, นางสาวนาตยา สุรปภา และ นางสาววัชรารมย์ อติเทพสถิต. 2550: การออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใสเพื่อการวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง (Design of Transparent Liquid Food Holder for Color Measurement Using Reflection Colorimeter) สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร. กิตติชัย บรรจง

บทคัดย่อ

การทดลองวัดสีอาหารเหลวชนิดโปร่งใสด้วยเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง (Minolta Colorimeter CR-300, Japan) นี้ ขึ้นแรกการหาอิทธิพลของขนาดพื้นที่หน้าตัดของภาชนะที่มีผลต่อการวัดสี ขนาดพื้นที่หน้าตัดตั้งฉากกับหัววัด 4 ขนาด โดยด้านตรงข้ามกับหัววัดสีติดฉากสีขาวและสีดำ พบว่าขนาดพื้นที่หน้าตัดของกล่องอะคริลิกไม่มีผลต่อค่า L, chroma, hue ของเหลวที่วัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ขั้นที่สอง ทดลองหาอิทธิพลของสีฉากที่ติดด้านตรงข้ามกับหัววัดและด้านข้าง ร่วมกับระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉาก 8 ระยะระหว่าง 1 ถึง 20 เซนติเมตร โดยใช้ภาชนะที่มีพื้นที่หน้าตัด 10×10 ตารางเซนติเมตร อาหารเหลวโปร่งใสที่ใช้ คือ น้ำแดง ตราเฮลล์บลูบอย น้ำเขียว ตราเฮลล์บลูบอย และน้ำส้ม ตราควีนแพนพบว่าภาชนะที่เหมาะสมกับการวัดอาหารเหลวโปร่งใส คือใช้ฉากสีขาวติดด้านตรงข้ามหัววัด เพราะค่า hue ที่วัดได้แสดงสีตรงตามที่มนุษย์มองเห็น กล่าวคือสีแดงให้ค่า hue ประมาณ 337 – 351 องศา ที่ระยะ 1-5 เซนติเมตร สีเขียวให้ค่า hue ประมาณ 160 - 175 องศา ที่ระยะ 1 เซนติเมตร และสีส้มให้ค่า hue ประมาณ 67 - 69 องศา ที่ทุกระยะ ตั้งแต่ระยะ 1 – 20 เซนติเมตร การทดลองเพื่อยืนยันผลของระยะที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 10 เซนติเมตร ติดฉากสีขาวด้านตรงข้ามกับหัววัด พบว่าที่ความเข้มข้นของตัวอย่างที่ 5% - 100% ยังคงวัดค่าสีของอาหารเหลวทั้งสามได้สีที่ระยะ 1 เซนติเมตร ซึ่งจะให้ค่า hue ตรงตามสีตัวอย่างทั้งสาม ส่วนค่า L และ chroma มีความสัมพันธ์กับความเข้มข้น กล่าวคือที่ความเข้มข้นสูงขึ้น L มีค่าลดลงหรือมีความสว่างน้อยลง และค่า chroma มีค่าสูงขึ้น หรือสีจะเข้มข้นนั่นเอง การทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของระยะระหว่างหัววัดกับฉาก ที่ระยะ 0.2, 0.6 และ 1 เซนติเมตร ของเหลวที่มีความเข้มข้น 5% - 100% พบว่า ค่าระยะที่ 0.2 เซนติเมตร ให้ค่าสีตรงตามที่เราเห็น สีแดงให้ค่า hue ประมาณ 2 – 20 องศา สีเขียวให้ค่า hue ประมาณ 137 - 179 องศา และสีส้มให้ค่า hue ประมาณ 77 – 94

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากผลการทดลองข้างต้น นำไปใช้ออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใสเพื่อการวัดค่าสีด้วยเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง โดยออกแบบให้มี ระยะการวัด 0.2 เซนติเมตร ฉากที่ใช้เป็นกระเบื้องสีขาวซึ่งมีค่า $L = 90.6$, $Chroma = 3.2$ และ $Hue = 88.4$ ภาชนะบรรจุนี้ทำจากอะคริลิกหนา 0.2 มิลลิเมตร การวัดผ่านอะคริลิกนี้ทำให้ระยะดังกล่าวไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากผู้ทำการทดลอง และเครื่องก็ไม่เกิดความเสียหาย



นิศมา อ้วนเส็ง

(นางสาวนิศมา อ้วนเส็ง)

นพชา สุปลุก

(นางสาวนพชา สุปลุก)

ภัทราภรณ์ อติเทพสถิต

(นางสาวภัทราภรณ์ อติเทพสถิต)

(ดร. กิตติชัย บรรจง)

อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ

๒๐ ธ.ค. ๕๑

วัน/เดือน/ปี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้จัดทำขอขอบคุณ ดร.กิตติชัย บรรจง ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้า ได้ให้ความกรุณาตลอดเวลามาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าข้อมูลต่างๆ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาพิเศษ ตลอดจนตรวจแก้ไขรายงานฉบับนี้ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด

นางสาวโชติกา อ้วนเส้ง
นางสาวนาตยา สุรปภา
นางสาววัชรภรณ์ อติเทพสถิต
21 มีนาคม 2550

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูป	ญ
บทที่ 1 บทนำ	1
วัตถุประสงค	1
บทที่ 2 วารสารปริทัศน์	2
2.1 การประเมินลักษณะปรากฏจากการมองเห็น	3
2.2 คุณสมบัติทางด้านแสงของตัวอย่าง	4
2.3 เครื่องมือ-อุปกรณ์	9
2.4 การเตรียมตัวอย่าง	10
2.5 ปัจจัยที่ทำให้เกิดสี	12
บทที่ 3 วัตถุประสงค์ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง	17
3.1 วัตถุประสงค์	17
3.2 อุปกรณ์	17
3.3 วิธีการทดลอง	17
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง	22
4.1 ศึกษาปัจจัยขนาดของพื้นที่หน้าวัด ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส	22
4.2 ศึกษาปัจจัยสีของฉาก ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส	26
4.3 ศึกษาปัจจัยของระยะจากหัววัดจนถึงฉากช่วง 1 – 10 เซนติเมตร ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส	39
4.4 ศึกษาปัจจัยระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉากที่ระยะ 0.2-1 เซนติเมตรและความเข้มข้นของน้ำแดงเฮลบลูบอยที่มีผลต่อการวัดสีอาหารเหลวโปร่งใส	59
4.5 การออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใส	75
4.6 เปรียบเทียบค่า L, Chroma, Hue ที่ทำการวัดโดยสัมผัสของเหลวโดยตรงกับ	76

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง	81
บรรณานุกรม	83
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	84



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลล์บลูบอย ที่ระดับความเข้มข้น 5% บรรจุในภาชนะที่ใช้ฉลากสีดำ ด้านข้าง มีลักษณะโปร่งใส ที่ขนาดพื้นที่หน้าตัดต่างๆ	23
4.2 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลล์บลูบอย ที่ระดับความเข้มข้น 100% ที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉลาก และสีของฉลากต่างๆ	27
4.3 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำเขียว ตราเฮลล์บลูบอย ที่ระดับความเข้มข้น 100% ที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉลาก และสีของฉลากต่างๆ	29
4.4 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำส้ม ตราโกลด์แพน ที่ระดับความเข้มข้น 100% ที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉลาก และสีของฉลากต่างๆ	31
4.5 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลล์บลูบอยเข้มข้น ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉลากต่างๆ	41
4.6 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลล์บลูบอย ความเข้มข้น 80% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉลากต่างๆ	41
4.7 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลล์บลูบอย ความเข้มข้น 60% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉลากต่างๆ	42
4.8 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลล์บลูบอย ความเข้มข้น 40% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉลากต่างๆ	42
4.9 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลล์บลูบอย ความเข้มข้น 20% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉลากต่างๆ	43
4.10 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลล์บลูบอย ความเข้มข้น 10% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉลากต่างๆ	43
4.11 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลล์บลูบอย ความเข้มข้น 5% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉลากต่างๆ	44
4.12 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำเขียว ตราเฮลล์บลูบอย เข้มข้น ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉลากต่างๆ	47

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.13 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำเขียว ตราเฮลล์ลูบอย ความเข้มข้น 80% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	47
4.14 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำเขียว ตราเฮลล์ลูบอย ความเข้มข้น 60% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	48
4.15 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำเขียว ตราเฮลล์ลูบอย ความเข้มข้น 40% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	48
4.16 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำเขียว ตราเฮลล์ลูบอย ความเข้มข้น 20% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	49
4.17 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำเขียว ตราเฮลล์ลูบอย ความเข้มข้น 10% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	49
4.18 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำเขียว ตราเฮลล์ลูบอย ความเข้มข้น 5% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	50
4.19 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำส้ม ตราโกลด์แพน เข้มข้นที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	53
4.20 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำส้ม ตราโกลด์แพน ความเข้มข้น 80% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	53
4.21 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำส้ม ตราโกลด์แพน ความเข้มข้น 60% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	54
4.22 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำส้ม ตราโกลด์แพน ความเข้มข้น 40% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	54
4.23 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำส้ม ตราโกลด์แพน ความเข้มข้น 20% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	55
4.24 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำส้ม ตราโกลด์แพน ความเข้มข้น 10% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	55
4.25 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำส้ม ตราโกลด์แพน ความเข้มข้น 5% ที่ระยะระหว่างหัววัด(1-10 เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	56

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีกรนำไปใช้

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.26 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลต์บลูบอย เข้มข้น ที่ระยะระหว่างหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	60
4.27 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลต์บลูบอย ความเข้มข้น 80% ที่ระยะระหว่างหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	60
4.28 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลต์บลูบอย ความเข้มข้น 60% ที่ระยะระหว่างหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	60
4.29 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลต์บลูบอย ความเข้มข้น 40% ที่ระยะระหว่างหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	61
4.30 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลต์บลูบอย ความเข้มข้น 20% ที่ระยะระหว่างหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	61
4.31 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลต์บลูบอย ความเข้มข้น 10% ที่ระยะระหว่างหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	61
4.32 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของน้ำแดง ตราเฮลต์บลูบอย ความเข้มข้น5% ที่ระยะระหว่างหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)กับฉากต่างๆ	62
4.33 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hueของตัวอย่างน้ำเขียวตราเฮลต์ บลูบอยเข้มข้น ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	65
4.34 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลต์ บลูบอย ความเข้มข้น 80 % ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	65
4.35 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลต์ บลูบอย ความเข้มข้น 60 % ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	65
4.36 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลต์ บลูบอย ความเข้มข้น 40 % ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	66
4.37 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลต์ บลูบอย ความเข้มข้น 20 % ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	66
4.38 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลต์ บลูบอย ความเข้มข้น 10 % ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	66

สารบัญตาราง(ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.39 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์ บลูส์บอย ความเข้มข้น 5 % ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	67
4.40 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน เข้มข้น ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)งฉากต่างๆ	70
4.41 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 80% ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	70
4.42 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 60% ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	70
4.43 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 40% ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	71
4.44 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 20% ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	71
4.45 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 10% ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	71
4.46 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 5% ที่ระยะจากหัววัด(0.2-1เซนติเมตร)ถึงฉากต่างๆ	72
4.47 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า Lค่า Chroma และค่า Hue ของน้ำแดง ตราเฮลบลูบอย วัดโดยการวัดผ่านอะคริลิก ระยะ 0.2 เซนติเมตร ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ	77
4.48 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า Lค่า Chroma และค่า Hue ของน้ำเขียว ตราเฮลบลูบอย วัดโดยการวัดผ่านอะคริลิก ระยะ 0.2 เซนติเมตร ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ	77
4.49 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า Lค่า Chroma และค่า Hue ของน้ำส้ม ตราโกสแพน วัดโดยการวัดผ่านอะคริลิก ระยะ 0.2 เซนติเมตร ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ	78

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 รูปแสดงมุมที่ตกกระทบและมุมสะท้อนเข้าสู่ตามนุษย์	3
2.2 รูปแสดงมุมของลักษณะการวัดสี	4
2.3 รูปแสดงตัวอย่างวัตถุทึบแสงที่ไม่ใช่โลหะและรูปแบบการสะท้อนแสง	5
2.4 ลักษณะการสะท้อนแสงของวัตถุทึบแสง	5
2.5 รูปแสดงตัวอย่างวัตถุทึบแสงที่เป็นโลหะและรูปแบบการสะท้อนแสง	6
2.6 รูปแสดงตัวอย่างวัตถุโปร่งแสงและรูปแบบการสะท้อนแสง	7
2.7 รูปแสดงตัวอย่างวัตถุโปร่งใสและรูปแบบการสะท้อนแสง	8
2.8 ลักษณะการผ่านทะลุของแสงของวัตถุโปร่งแสงและโปร่งใส	8
2.9 การบรรยายสีในระบบ CIE Lab มองในระนาบ 2 มิติ : Hue บรรยายถึงเฉดสี Chroma บรรยายถึงความมันวาวหรือความเข้มของโทนสี	14
2.10 การบรรยายสีพื้นในระบบ CIE Lab ในรูป 3 มิติ	15
3.1 แสดงลักษณะของกล่องสีเหลี่ยมที่ออกแบบ	17
4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า L กับพื้นที่หน้าตัดของน้ำแดงตราเฮลล์บรูยที่ระดับความเข้มข้น 5% บรรจุในภาชนะที่ใช้ฉลากสีดำด้านข้างมีลักษณะโปร่งใส	24
4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า chroma กับพื้นที่หน้าตัดของน้ำแดงตราเฮลล์บรูยที่ระดับความเข้มข้น 5% บรรจุในภาชนะที่ใช้ฉลากสีดำด้านข้างมีลักษณะโปร่งใส	24
4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า hue กับพื้นที่หน้าตัดของน้ำแดงตราเฮลล์บรูยที่ระดับความเข้มข้น 5% บรรจุในภาชนะที่ใช้ฉลากสีดำด้านข้างมีลักษณะโปร่งใส	25
4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า L กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่สีฉากต่างๆของน้ำแดงตราเฮลล์บรูยที่ระดับความเข้มข้น 100%	31
4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า chroma กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่สีฉากต่างๆของน้ำแดงตราเฮลล์บรูยที่ระดับความเข้มข้น 100%	33
4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า hue กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่สีฉากต่างๆของน้ำแดงตราเฮลล์บรูยที่ระดับความเข้มข้น 100%	34

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า L กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่สีฉากต่างๆของน้ำเขียวเฮลล์ลูบอยที่ระดับความเข้มข้น 100%	35
4.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า chroma กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่สีฉากต่างๆของน้ำเขียวเฮลล์ลูบอยที่ระดับความเข้มข้น 100%	35
4.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า hue กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่สีฉากต่างๆของน้ำเขียวเฮลล์ลูบอยที่ระดับความเข้มข้น 100%	36
4.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า L กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่สีฉากต่างๆของน้ำส้มตราโกลแพนค์ที่ระดับความเข้มข้น 100%	37
4.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า chroma กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่สีฉากต่างๆของน้ำส้มตราโกลแพนค์ที่ระดับความเข้มข้น 100%	37
4.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า hue กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่สีฉากต่างๆของน้ำส้มตราโกลแพนค์ที่ระดับความเข้มข้น 100%	38
4.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉาก(1-10 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ L ของตัวอย่างน้ำแดงตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	45
4.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉาก(1-10 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ chroma ของตัวอย่างน้ำแดงตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	45
4.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉาก(1-10 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ hue ของตัวอย่างน้ำแดงตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	46
4.16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉาก(1-10 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ L ของตัวอย่างน้ำเขียวตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	51
4.17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉาก(1-10 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ chroma ของตัวอย่างน้ำเขียวตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	51
4.18 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉาก(1-10 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ hue ของตัวอย่างน้ำเขียวตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	52
4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉาก(1-10 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ L ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกลแพนค์ที่ทุกๆความเข้มข้น	57

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(1-10 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ chroma ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพนค์ที่ทุกๆความเข้มข้น	57
4.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(1-10 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพนค์ที่ทุกๆความเข้มข้น	58
4.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(0.2-1 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ L ของตัวอย่างน้ำแดงตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	63
4.23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(0.2-1 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ chroma ของตัวอย่างน้ำแดงตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	63
4.24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(0.2-1 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ hue ของตัวอย่างน้ำแดงตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	64
4.25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(0.2-1 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ L ของตัวอย่างน้ำเขียวตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	68
4.26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(0.2-1 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ chroma ของตัวอย่างน้ำเขียวตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	68
4.27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(0.2-1 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ hue ของตัวอย่าง น้ำเขียวตราเฮลล์ลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น	69
4.28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(0.2-1 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ L ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพนค์ที่ทุกๆความเข้มข้น	73
4.29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(0.2-1 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ chroma ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพนค์ที่ทุกๆความเข้มข้น	73
4.30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(0.2-1 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ยของ hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพนค์ที่ทุกๆความเข้มข้น	74
4.31 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(0.2 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ย L ของตัวอย่าง(น้ำแดง,น้ำเขียวและน้ำส้ม)โดยวัดผ่านอะคริลิก	79
4.32 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัวใจถึงฉาก(0.2 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ย chroma ของตัวอย่าง(น้ำแดง,น้ำเขียวและน้ำส้ม)โดยวัดผ่านอะคริลิก	79

สารบัญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.33	80

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดกับฉาก(0.2 เซนติเมตร)กับค่าเฉลี่ย hue ของตัวอย่าง(น้ำแดง,น้ำเขียวและน้ำส้ม)โดยวัดผ่านอะครีติก



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

บทนำ

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทางกายภาพหรือการวัดคุณลักษณะของอาหาร มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากคุณลักษณะของอาหารนี้เป็นสิ่งแรกที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเพื่อเลือกซื้อสินค้า จนกระทั่งทำให้ผู้บริโภค เกิดความประทับใจและยังคงบริโภคสินค้าของเราอยู่เสมอ การตรวจสอบและควบคุมทางกายภาพนี้มีหลายปัจจัยที่ใช้ในการตรวจสอบ เช่น การวัดขนาดและรูปร่าง การวัดความหนืด การวัดสีของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ต้องทำการควบคุมและตรวจสอบตั้งแต่วัตถุดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต จนกระทั่งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านสีนี้สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพ ความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตมานั้น เกิดความสมบูรณ์ของการผลิตหรือไม่ มากน้อยเพียงใด จนกระทั่งขั้นตอนการขนส่งและการเก็บรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม สีที่มีลักษณะที่ดี ดูแล้วต้องเกิดความรู้สึกน่ารับประทานและมีความสม่ำเสมอในแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้เกิดความเชื่อถือและการยอมรับจากผู้บริโภค ในปัจจุบันการวัดสีในอุตสาหกรรมอาหาร นิยมใช้เครื่องวัดสีที่อาศัยหลักการการสะท้อนแสง (Munsell CR-300, Japan) ซึ่งเครื่องมือนี้นิยมใช้กับอาหารที่เป็นของแข็งและมีลักษณะที่บดแสงส่วนอาหารเหลวนิยมใช้เครื่องมือที่มีความเฉพาะ ซึ่งมีราคาสูง ดังนั้นจึงได้ทำการออกแบบภาชนะบรรจุตัวอย่างของเหลวชนิดโปร่งใสที่ทำให้การสะท้อนแสงของเครื่องเกิดขึ้นได้น้อย เครื่องไม่สามารถตรวจค่าสีได้ถูกต้อง เพื่อนำมาประยุกต์ในการวัดสีด้วยเครื่องแบบสะท้อนแสงนี้ การออกแบบนี้ ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าการวัดสี ซึ่งได้แก่ ขนาดพื้นที่หน้าตัด สีของฉาที่ใช้ ระยะจากหัววัดถึงฉาที่เหมาะสม

วัตถุประสงค์

1. ออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใสเพื่อใช้วัดสีด้วยเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมียผลต่อค่าที่ได้จากการวัดได้แก่ พื้นที่หน้าตัด สีของฉาที่ทำให้เกิดการสะท้อนของเครื่องวัด ระยะจากหัววัดจนถึงฉา
2. เปรียบเทียบผลการวัดค่าสีเมื่อใช้ภาชนะบรรจุอาหารเหลวชนิดโปร่งใสที่สร้างขึ้น ว่า

ให้ผลถูกต้องตามสีของตัวอย่างที่ปรากฏหรือไม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ไม่สามารถนำออกเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการ โทร. 0-2916-1111 หรือ e-mail: academic@kmitl.ac.th

บทที่ 2 วารสารปริทัศน์

สีเป็นคุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของอุตสาหกรรมอาหาร ผู้บริโภคมักเลือกบริโภคสินค้าโดยตัดสินจากลักษณะปรากฏโดยรวมทั้งหมดซึ่งรวมถึงสีของผลิตภัณฑ์ด้วยและสีมักสัมพันธ์กันกลิ่นรสของอาหารด้วยเสมอ ดังนั้นการประเมินและตรวจสอบสีของผลิตภัณฑ์อาหารจึงมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปัจจัยอื่นๆที่ใช้ในการประเมินคุณภาพสินค้า

การประเมินคุณลักษณะทางด้านสีของอาหาร

- เพื่อเป็นตัวตัดสินและสนับสนุนผลทางด้านคุณภาพขององค์ประกอบของสีของผลิตภัณฑ์อาหาร
- เพื่อเป็นการกำหนดสีของอาหารในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผลของการเก็บรักษาผลจากการผ่านกระบวนการแปรรูป และจากปัจจัยอื่นๆ
- เพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพระดับสีในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหาร
- เป็นการทดสอบทางด้านคุณภาพ เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ความสอดคล้องกันตั้งแต่ตัววัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

การประเมินค่าสีโดยใช้การมองเห็นด้วยสายตาของผู้ตรวจสอบเองนั้นก็สมารถทำได้ แต่มีข้อบกพร่องในเรื่องผลของการประเมินที่แปรปรวนไม่แน่นอน ดังนั้นจึงควรทำให้การประเมินทางด้านสีผลิตภัณฑ์น่าเชื่อถือมากกว่านี้ อาจทำได้โดยทางควบคุมความแปรปรวนของผลที่วัดได้ นั่นคือควบคุมแหล่งกำเนิดแสงที่ส่องไปยังตัวผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐาน ความเข้มแสงของแหล่งกำเนิด มุมของแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ ทิศทางแสงที่พุ่งเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ ทิศทางการมอง ระยะระหว่างตัวอย่างจนถึงหัวอ่านที่เป็นเซ็นเซอร์ และตัวผู้สังเกตเอง

2.1 การประเมินลักษณะปรากฏจากการมองเห็น (Insight on Color, 2000)



Visual evaluation of color with the light illuminating the sample from a 45° angle and the viewing from directly over the sample.

รูปที่ 2.1 รูปแสดงมุมที่ตกกระทบและมุมการสะท้อนเข้าสู่ตามนุษย์


ที่มา : Hunter Lab, 2000

โดยปกติแล้วคนเราควรทำการประเมินความมันวาวจากการมองเห็นภายนอกในมุมการมองที่เท่าๆกัน คือ มุมที่แสงตกกระทบไปยังผิววัตถุควรเท่ากับมุมที่แสงสะท้อนกลับมา แสงสว่างควรส่องไปยังผิวส่วนบนของวัตถุ และควรทดสอบตัวอย่างจากมุม 45° นอกจากนี้ยังมีชี้แนะสำหรับเงื่อนไขการมองเห็นดังต่อไปนี้

- แหล่งกำเนิดแสง : ควรใช้หลอดไฟที่เป็นชนิด daylight , incandescent หรือ cool white fluorescent แต่การเลือกใช้นั้นควรระบุแหล่งของแสงที่ใช้ด้วย
- ความเข้มแสง : 75-175 ft candles
- แสงการส่องไปยังส่วนบนของวัตถุ โดยทำมุม 0° และมีมุมการมองที่ 45° หรือให้มุมที่ส่องไปอยู่ที่ 45° ส่วนมุมการมองอยู่ที่ 0°
- พื้นหลังที่ใช้เป็นฉาก ควรเป็นสีกลาง คือ สีเทา ตลอดทั้งพื้นหลัง การเปรียบเทียบนั้นจะต้องวางวัตถุทั้งสองในตำแหน่งที่เหมาะสมและถูกต้อง วางติดกัน แต่ไม่ควรวางซ้อนทับกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Color Measurement Geometry

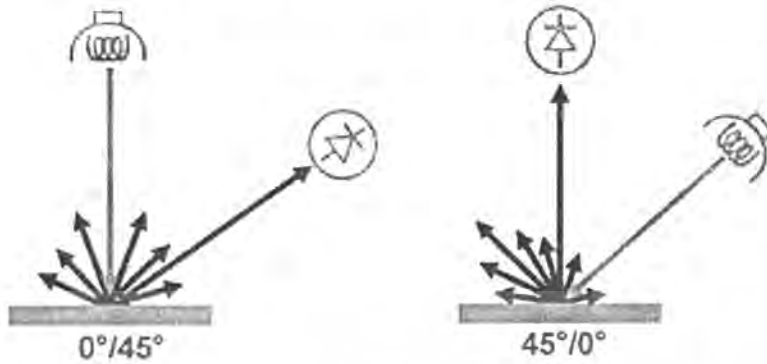

รูปที่ 2.2 รูปแสดงมุมของลักษณะการวัดสี
ที่มา : Hunter Lab, 2000

2.2 คุณสมบัติทางด้านแสงของตัวอย่าง (Insight on Color, 2000)

วัตถุต่างๆมักเกี่ยวพันในการมองเห็นสีและลักษณะปรากฏของตัวมันเองอยู่แล้ว โดยการแปรเปลี่ยนตามแสงจากแหล่งกำเนิดแสง, สารให้สีในตัววัตถุ (pigment หรือสีย้อม) จะดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นช่วงหนึ่งและสะท้อนหรือกระจายช่วงความยาวคลื่นอีกช่วงหนึ่ง เช่น วัตถุสีแดงจะสะท้อนช่วงความยาวคลื่นของแสงสีแดง และดูดกลืนช่วงความยาวคลื่นแสงอื่นๆทั้งหมด การที่เกิดการสะท้อนแสงสีแดงออกมานั้นทำให้เรามองเห็นวัตถุนั้นเป็นสีแดง


วัตถุที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวัดสีและเกี่ยวข้องกับแสงนั้นแบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่

2.2.1. วัตถุทึบแสงที่ไม่เป็นโลหะ (Opaque Nonmetal)


เป็นวัตถุที่ไม่ใช่โลหะและไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านได้ เช่น วัตถุพวกลพลาสติก หรือ ไม้ เป็นต้น วัตถุพวกนี้จะมีการสะท้อนแสงที่ปรากฏออกมา 2 ลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ การสะท้อนแสงแบบเสมือน ซึ่งเป็นการสะท้อนแสงไปและกลับในปริมาณที่เท่ากัน หรือทำให้เราเห็นความแวววาวจากตัววัตถุ การสะท้อนแบบเสมือนนี้จะเกิดขึ้นเพียง 4% ของการสะท้อนแสงทั้งหมด ส่วนอีก 96% เป็นการสะท้อนแสงแบบกระจาย สีของวัตถุที่เราเห็นนั้นมาจากการสะท้อนแบบกระจายแสงนี้เอง แต่ลักษณะปรากฏทั้งหมดของวัตถุนั้นอาศัยการสะท้อนแสงทั้งสองลักษณะ

การสะท้อนแสงทั้งหมด (Total Reflection) = specular reflection + diffuse reflection

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

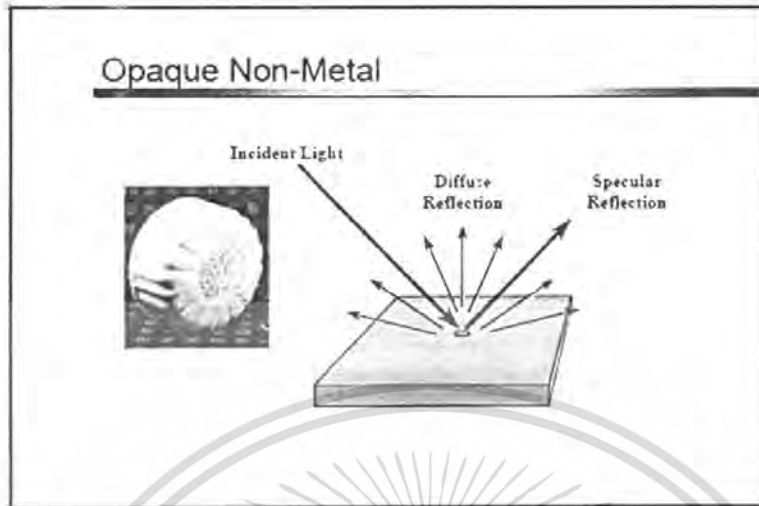

รูปที่ 2.3 รูปแสดงตัวอย่างวัตถุทึบแสงที่ไม่ใช่โลหะและรูปแบบการสะท้อนแสง
ที่มา : Hunter Lab, 2000

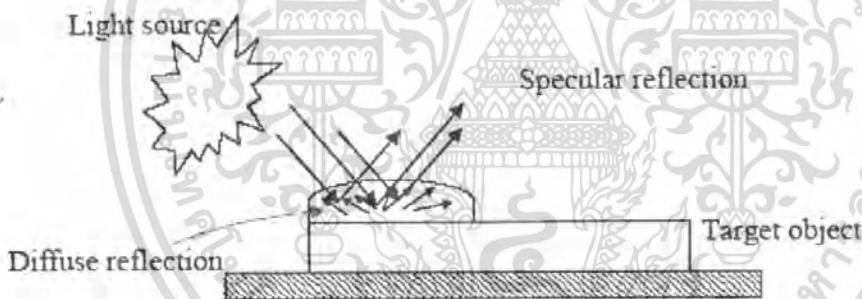


รูปที่ 2.4 ลักษณะการสะท้อนแสงของวัตถุทึบแสง
ที่มา : Minalta , 1997

2.2.2 วัตถุทึบแสงที่เป็นโลหะ (Opaque Metal)

เป็นวัตถุที่เป็นโลหะและไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านได้ เช่น กระตะอลูมิเนียม, ทองคำ หรือสิ่งของที่เคลือบด้วยตัวโลหะ วัตถุทึบแสงที่เป็นโลหะนี้คล้ายกับวัตถุทึบแสงที่ไม่เป็นโลหะ นั่นคือเกิดการสะท้อนแสง 2 ลักษณะ คือ การสะท้อนแสงแบบเสมือนและการสะท้อนแสงแบบกระจายแสง แต่พวกที่เป็นโลหะนี้จะมีความแวววาวมากกว่า โดยที่ความแวววาวของสีที่เห็นนี้มาจากการสะท้อนแสงแบบเสมือนนี้จะเกิดขึ้นมากกว่า ส่วนการสะท้อนแสงแบบกระจายแสงนั้นเกิดขึ้นในอีกลักษณะหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งหรือสีหนึ่งหรือสีหนึ่งหรือสีหนึ่ง เมื่อผู้ดูได้เห็น สีเขียวหรือสีอื่นด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ปริมาณน้อย ทั้งนี้เกิดจากความแตกต่างของบริเวณพื้นผิว ส่วนสีที่เราเห็นจากวัตถุชนิดนี้นั้นเกิดจากการสะท้อนแบบกระจายแสง

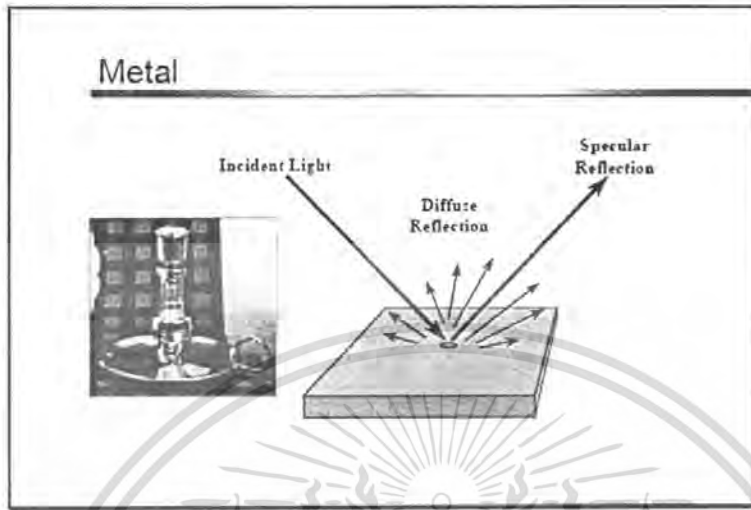


รูปที่ 2.5 รูปแสดงตัวอย่างวัตถุทึบแสงที่เป็นโลหะและรูปแบบการสะท้อนแสง
ที่มา : Hunter Lab,2000

2.2.3 วัตถุโปร่งใส (Transparent Materials)

วัตถุโปร่งใสนี้จะยอมให้แสงทะลุผ่านได้ในปริมาณมาก ซึ่งเราสามารถมองเห็นวัตถุอีกอย่างหนึ่งผ่านตัววัตถุโปร่งใสนี้ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าวัตถุชนิดนี้จะแข็งหรือเหลว เช่น กระจกใส หรือน้ำ แสงส่วนหนึ่งที่สะท้อนแบบเสมือนนั้นจะทำให้เราเห็นความมันวาวที่ผิวของวัตถุ ส่วนแสงอีกส่วนหนึ่งจะทะลุผ่านตัววัตถุนี้ การทะลุผ่านของแสงนี้มีทั้งแบบที่ทะลุผ่านเป็นเส้นตรงและทะลุผ่านตัววัตถุแบบกระจัดกระจาย สีที่เรามองเห็นจากวัตถุชนิดนี้เกิดจากการทะลุผ่านของแสงเป็นเส้นตรง แต่ถ้าเกิดการทะลุผ่านของแสงแบบกระจัดกระจายในปริมาณมากจะทำให้เห็นวัตถุในลักษณะขุ่นมัว ไม่ชัดเจน หากเราต้องการวัดค่าสีของวัตถุนี้เราต้องทำการวัดค่าการผ่านทะลุของแสงทั้งหมด ถ้าหากต้องการวัดความแวววาวของตัววัตถุจะตัววัดค่าการสะท้อนแสงแบบเสมือน หรือต้องการวัดความขุ่นมัวของสีวัตถุก็วัดได้จากการผ่านทะลุของแสงแบบกระจัดกระจาย

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

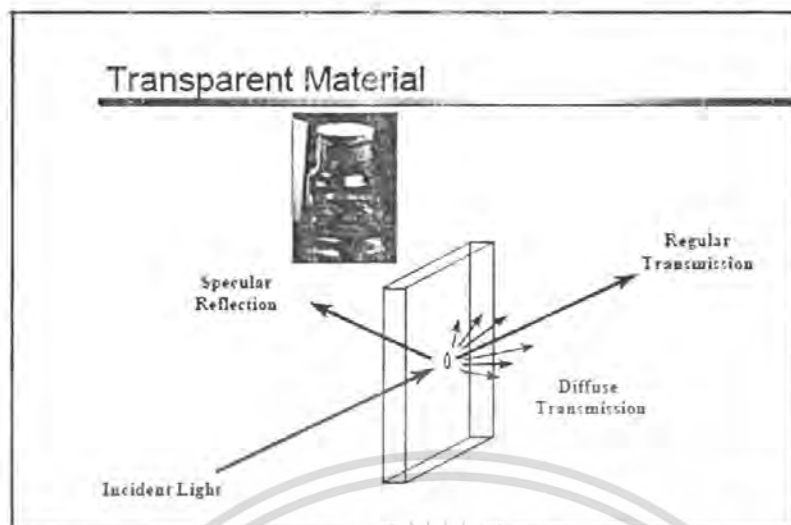


รูปที่ 2.6 รูปแสดงตัวอย่างวัตถุโปร่งใสและรูปแบบการสะท้อนแสง

ที่มา : Hunter Lab.2000

2.2.4 วัตถุโปร่งแสง (Translucent Materials)

วัตถุโปร่งแสงนี้เป็นได้ทั้งของแข็งและของเหลว วัตถุเหล่านี้จะยอมให้แสงทะลุผ่านเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แม้แสงที่ผ่านเข้าสู่วัตถุโปร่งแสง แต่ก็ไม่สามารถมองเห็นภาพของวัตถุอื่นๆผ่านวัตถุโปร่งแสงนี้ได้ชัดเจน ตัวอย่างของวัตถุชนิดนี้ ได้แก่ น้ำส้ม กระจกอย่างบาง ฯลฯ วัตถุชนิดนี้มีความซับซ้อน เนื่องจากการรวมลักษณะของวัตถุทึบแสงที่ไม่ใช่โลหะและวัตถุโปร่งใสเข้าด้วยกัน ความแวววาวจากวัตถุนี้เกิดขึ้นจากรากฏการณ์การสะท้อนแสงแบบกระจายแสง เมื่อแสงผ่านเข้าทางด้านหน้าของวัตถุ ส่วนการมองเห็นที่เกิดจากการทะลุผ่านของแสงแบบกระจัดกระจาย เมื่อแสงอยู่ทางด้านหลังของวัตถุ วัตถุโปร่งแสงนี้ได้สามารถทำการวัดสีได้โดยง่ายเนื่องจากอาจเกิดความแปรปรวนตามความหนาของวัตถุหรือพื้นหลังที่นำมาเป็นฉาก


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

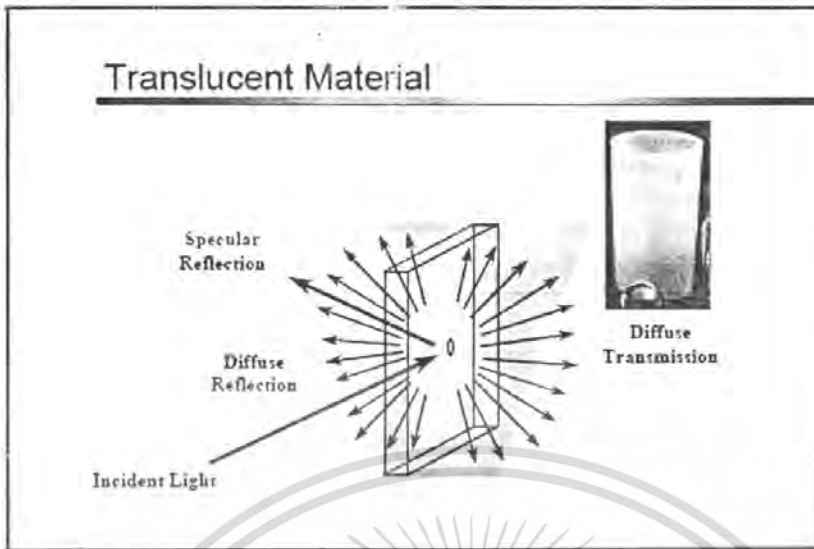

รูปที่ 2.7 รูปแสดงตัวอย่างวัตถุโปร่งแสงและรูปแบบการสะท้อนแสง

ที่มา : Hunter Lab, 2000

การทะลุผ่านแสงทั้งหมด (total transmission) = regular transmission + diffuse transmission

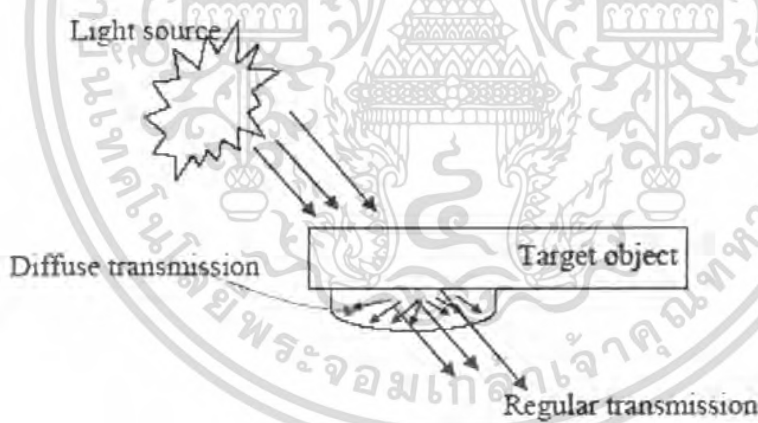

รูปที่ 2.8 ลักษณะการผ่านทะลุของแสงของวัตถุโปร่งแสงและโปร่งใส

ที่มา : Minalta , 1997

ได้มีการทดลองเพื่อหาวิธีการวัดค่าสีที่ดีที่สุดของวัตถุโปร่งแสงในส่วนของ การสะท้อนแสง ดังนี้

- กำหนดความหนาและแสงที่ส่องผ่านให้แน่นอนและสม่ำเสมอ และอาจใช้เชื้อบางๆ เพื่อให้วัตถุมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงความทึบแสง

พื้นที่หลังที่นำมาเป็นฉากควรเป็นสีขาว

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์บุรีรัมย์ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- ปกคลุมตัวอย่างด้วยวัสดุสีดำ เพียงให้แสงผ่านเข้าไปใน รีมาร์ ม็อย
- ใช้พื้นที่เล็กๆในการให้แสงส่องสว่าง และใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในการมองวัตถุ

2.3 เครื่องมืออุปกรณ์ (Insight on Color, 2000)

เครื่องมือที่ใช้วัดสี เป็นการวัดสีโดยตรงที่ให้ผลที่ถูกต้องตรงไปตรงมามากกว่าการวัดสีโดยใช้คน เนื่องจากคนที่เป็นผู้สังเกตนั้นอาจยังมีความอคติในการตัดสินใจบ้าง อีกทั้งเครื่องมือยังมีความแม่นยำมากกว่า ใช้เวลาในการวัดน้อยกว่า และยังมีข้อดีอื่นๆที่ทำให้ผลการวัดออกมาง่ายและเป็นมาตรฐาน เครื่องมือวัดสีที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหารมี 3 ประเภท คือ monochromatic colorimeter, tristimulus colorimeter และ spectrophotometer

สำหรับ monochromatic colorimeter ทำการวัดโดยอาศัยการสะท้อนแสงในพื้นที่เล็กๆที่ประกอบด้วยสีแดง สีเขียว สีเหลือง หรือสีฟ้า เนื่องจากพื้นฐานของเครื่องชนิดนี้จะเห็นเพียงส่วนที่เป็นสีแดงทั้งหมด สีเขียวทั้งหมด สีฟ้าทั้งหมด หรือสีเหลืองทั้งหมด ดังนั้นจึงเกิดความผิดพลาดของผลที่วัดออกมาได้ง่าย เคยมีผู้ทดลองนำเครื่องชนิดนี้มาใช้ในการแยกความเป็นสีน้ำตาลของผลิตภัณฑ์อาหารเข้าจำพวกซีเรียลที่เกิดจากการอบ ปรากฏว่าเครื่องนี้ไม่สามารถแยกได้กว่าผลิตภัณฑ์เซทไคที่มีความเป็นสีน้ำตาลแก่อ่อนกว่ากัน และระบุว่าผลิตภัณฑ์ทุกเซทไคมีสีน้ำตาลเหมือนกัน นั่นคือเครื่องประเภทนี้ไม่สามารถแยกเฉดความแก่อ่อนของสีต่างๆได้ แต่ข้อดีของเครื่องนี้คือสามารถเห็นได้ในพื้นที่ที่กว้างประมาณช่วงรัศมี 3 นิ้ว และยังใช้ได้ดีกับพวกที่มีผิวหน้าขรุขระ

สำหรับ tristimulus colorimeter ก็สามารถมองเห็นได้เป็นบริเวณกว้างและยังสามารถวัดได้ค่าสีที่แท้จริงที่สอดคล้องกับสีที่ตามนุษย์เห็น เครื่องนี้จะทำงานคล้ายตาและสมองที่ไวต่อค่าสีของมนุษย์ โดยการทำงานพร้อมกันของระจกชนิดพิเศษที่ใช้ในการกรองสีและตัวตรวจจับสี (light detector) ปกติแล้วตาของมนุษย์นั้นสามารถตรวจจับค่าสีได้มากกว่า 10 ล้านเฉดสี ซึ่งเครื่องนี้ก็สามารมองเห็นเฉดสีมากใกล้เคียงกับตาของมนุษย์ เนื่องจากสามารถตรวจจับได้ในบริเวณกว้าง อีกทั้งยังมีระบบการวัดสีที่เชื่อมโยงในการวัดผิวของตัวอย่างที่ขรุขระ เช่น ผลิตภัณฑ์พวกซีเรียลขนมขบเคี้ยวมีผิวขรุขระ เส้นพาสต้า เส้นบะหมี่ ฯลฯ

ส่วน spectrophotometer เช่นเดียวกับเครื่อง tristimulus colorimeter ก็สามารถวัดได้สีที่แท้จริงแต่มีหลักการการทำงานที่แตกต่างกันออกไป คือจะทำการวัดโดยให้แสงผ่านเข้าทางสเปกตรัมไปตกกระทบและสะท้อนจากตัวอย่าง และใช้ตารางทางคณิตศาสตร์ที่ทำหน้าที่เหมือนตามนุษย์ที่ตีความว่องไว อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็น color output ของแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันออกไป จากนั้นก็นำมาคำนวณและประมวลผลออกมา เครื่อง spectrophotometer นี้มีความแม่นยำ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มากกว่าเครื่อง tristimulus colorimeter ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเครื่องทั้งสองที่กล่าวมาไว้ แต่เครื่องชนิดนี้ไม่สามารถวัดได้ในบริเวณที่กว้างเท่ากับแบบ tristimulus colorimeter ดังนั้นจึงใช้วัดได้ก็ดีกว่าอย่างที่มีผิวไม่ขรุขระมากนัก แต่เครื่องมือชนิดนี้ใช้วัดตัวอย่างที่เป็นของเหลวได้ดี

2.4 การเตรียมตัวอย่าง (Insight on Color, 2000)

ตัวอย่างอุดมคติเป็นตัวอย่างที่มีลักษณะที่ทำให้ค่าการวัดสีเกิดความแน่นอนและแม่นยำ ซึ่งมีลักษณะ ทึบแสง มีรูปร่างที่แน่นอน มีผิวเรียบตลอดทั้งตัววัตถุ มีความเป็นเนื้อเดียวกันไม่แยกชั้น และอย่างน้อยที่สุดควรมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่ใช้ยึดจับของตัวเครื่องเล็กน้อย และไม่ควรเป็น photochromic ซึ่งทำให้สีเปลี่ยนแปลงตามค่าของแสง และ thermochromic ซึ่งทำให้สีเปลี่ยนแปลงไปตามค่าความร้อน ตัวอย่างที่เลือกมาจะต้องเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาวัดได้เป็นอย่างดีโดยมีลักษณะที่ปรากฏบนตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนหลักในตัวอย่างที่นำมาใช้วัดด้วย อีกทั้งตัวอย่างควรมีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างอุดมคติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ส่วนตัวอย่างที่จะนำมาวัดการสะท้อนแสงนั้น จะต้องไม่ทึบแสงอาจทำได้โดยใช้กระเบื้องสีขาวเป็นฉากในการวัดเพื่อช่วยในเรื่องการสะท้อนของแสง ส่วนตัวอย่างที่เป็นวัตถุที่ไม่ทึบแสงอยู่แล้วก็สามารถนำมาวัดการสะท้อนแสงได้เลย ตัวอย่างที่มีรูปร่างไม่แน่นอน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงหรือเป็นเม็ดขนาดเล็ก อาจต้องบดให้ผงนั้นมีขนาดและรูปร่างที่แน่นอนเสียก่อน แต่ถ้าเป็นตัวอย่างที่เป็นของแข็งที่ขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน เช่น พวกสิ่งทอทั้งหลายในกรณีเช่นนี้จะต้องแบ่งส่วนที่เหมือนหรือคล้ายกันนำมาวัดด้วยกัน หรืออาจวัดบริเวณที่เป็นส่วนหลักของตัวอย่างนั้น ส่วนตัวอย่างที่มีผิวไม่เรียบเสมอกันตลอด อาจทำโดยกดอัดให้ตัวอย่างเรียบเสียก่อนและวัดบริเวณนั้น หรืออาจกดอัดลงใน pellet (กรณีที่เป็นผง) แต่ถ้าตัวอย่างมีลักษณะไม่เป็นเนื้อเดียวกันอาจทำได้โดยคนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนทำการวัด

2.4.1 วิธีการนำเสนอตัวอย่าง

มีวิธีการมากมายที่แตกต่างกันออกไปในการแสดงตัวอย่างที่ใช้กับเครื่องมือ ถ้าเราจับตัวอย่างที่เป็นผงควรจะเทลงในถ้วยใส่ตัวอย่างและทำการวัดด้วยเครื่องโดยผ่านกระจกซึ่งจะช่วยในการกดอัดไปในตัว หรือวัดโดยนำตัวอย่างไปละลายน้ำเสียก่อนแล้วค่อยวัดการทะลุผ่านของแสง หรืออาจใช้กระเบื้องเป็นฉากในการวัด หรือปกคลุมด้วยที่ดักแสง หรือทำการวัดหลายๆครั้งแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย เนื่องจากในแต่ละครั้งของการวัดอาจเกิดค่าที่แตกต่างเนื่องจากปัจจัยการวัดต่างๆ วิธีที่เลือกมาใช้นั้นควรจะระบุหรือเลือกให้เหมาะกับเครื่องมือด้วย (Hunter Lab, 2003)

แนวทางในการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่ใช้ได้ผลมากที่สุด ตัวอย่างควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

- การเตรียมและการวัดนั้นมีหลายขั้นตอน จึงควรตรวจสอบแต่ละขั้นอย่างรอบครอบ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- เมื่อตัวอ้อมมีหลากหลายควรทำการวัดและเปรียบเทียบ เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของพารามิเตอร์ทั้งหมดว่ามีความสัมพันธ์สิ่งที่เตรียมมาอย่างไร
- ควรทำการวัดในบริเวณที่สะอาด มีอากาศถ่ายเทที่ดี และมีแสงจากธรรมชาติส่องเข้ามาให้มากที่สุด หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีไอก๊าซพิษและฝุ่น เนื่องจากจะเกิดการเข้าไปสะสมในส่วนประกอบต่างๆของเครื่องมือได้และทำให้เครื่องมือเสื่อมประสิทธิภาพหรือชำรุดไปมากที่สุด
- ใช้พื้นที่การมองที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- วัดหลายๆครั้งในแต่ละตัวอย่างและทำการหาค่าเฉลี่ยจากค่าที่อ่านได้
- หลีกเลี่ยงการวัดในบริเวณที่เป็นจุดบกพร่อง

2.5 ความแตกต่างของ Colorimeter และ Spectrophotometer (Insight on Color, 2000)

เป็นที่ทราบกันดีว่าชนิดของเครื่องมือ มีผลต่อการวัดสีและมีความสำคัญในการเลือกใช้ให้เหมาะสม ในเทอมของ colorimeter และ spectrophotometer อาจก่อให้เกิดความสับสน ดังนั้นจึงมีการแยกแยะความแตกต่างโดยสังเขปของเครื่องทั้งตามตารางข้างล่างนี้ อย่างไรก็ตาม เครื่องทั้งสองประเภทนี้มีช่วงความยาวคลื่นแสงที่ใช้ในการมองเห็นเหมือนกันคือประมาณ 400-700 นาโนเมตร (Hunter Lab, 2004)

Colorimeter	Spectrophotometer
<ul style="list-style-type: none"> • เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางกายภาพ โดยการวัดที่ได้ค่อนข้างสัมพันธ์กับการมองเห็นของตาและสมองมนุษย์ ส่วนข้อมูลที่อ่านได้จะประมวลผลออกมาในค่าของ XYZ , L-a-b ฯลฯ • ส่วนประกอบของเครื่อง ได้แก่ sensor และ simple data processor 	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางกายภาพ โดยใช้ความยาวคลื่นของสเปกตรัมในการวิเคราะห์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นด้วยตาของมนุษย์แต่อย่างใด อีกทั้งยังมีระบบคำนวณที่ชาญฉลาดในการประมวลผลออกมาเป็นข้อมูล • ส่วนประกอบของเครื่อง ได้แก่ sensor ที่มีส่วนของ data processor หรือ software

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

<ul style="list-style-type: none"> • คว ใช้กับ แหล่งรวมแสงเพียงแหล่งเดียว ที่มีค่า $2^{\circ}/C$ • สามารถแยกช่วงความยาวคลื่นที่กว้าง โดยใช้ tristimulus absorption filter • มีประสิทธิภาพน้อยกว่าเครื่องแบบ spectrophotometer • ใช้ในงานที่เปรียบเทียบสีที่คล้ายกัน และยังใช้กับการปรับสีที่แตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขที่ต่อเนื่อง อีกทั้งยังเหมาะสมมากในงานตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด • ตัวอย่างของ colorimeter ได้แก่ HunterLab D25-SERIES instrument 	<ul style="list-style-type: none"> • สามารถใช้ได้กับแหล่งรวมแสงที่หลากหลาย ซึ่งเครื่องมีโปรแกรมคำนวณรองรับอยู่ • สามารถแยกแยะช่วงความยาวคลื่นในบริเวณแคบได้ โดยใช้ปริซึม ตะแกรงที่มีช่องขนาดเล็ก หรือตัวกรอง • มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องแบบ colorimeter เนื่องจากการทำงานที่ซับซ้อนกว่า • ใช้การคำนวณค่าสี ใช้ได้ดีแม้แหล่งรวมแสงจะแปรปรวน เหมาะกับการใช้งานทั้งการวัดอย่างละเอียดและงานวิจัยและพัฒนา (R&D) • ตัวอย่างของ spectrophotometer ได้แก่ HunterLab color QUEST, LabScan, MiniScan, UltraScan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6 ปัจจัยที่ทำให้เกิดสี แบ่งเป็น 3 ประเภท


2.6.1. แหล่งกำเนิดแสง (Light Sour) แหล่งกำเนิดแสงมีผลอย่างมากในการบรรยายสีของวัตถุ แหล่งกำเนิดแสงถ้ามีแสงแตกต่างจากแสงขาว เมื่อตกกระทบวัตถุจะทำให้แสงที่สะท้อนกลับมาเกิดสีแตกต่างกัน เช่น แสงจากหลอด Incandescent จะให้แสงสีส้ม ในขณะที่ Fluorescent ให้แสงขาวเย็น

2.6.2. วัตถุที่มอง (Specimen) วัตถุที่ทึบแสง (Opaque) จะให้การสะท้อนแสงที่เกิดสีแตกต่างจากวัตถุโปร่งแสง (Translucent) และวัตถุโปร่งใส (Transparent) ลักษณะการตกกระทบของแสงบนวัตถุ ซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2.6.3 ผู้สังเกต (observer) ผู้สังเกตนั้นมีผลต่อการบรรยายสีที่มองเห็นอย่างยิ่ง ผู้สังเกตต่างคนจะบรรยายลักษณะสีต่างกันขึ้นกับลักษณะทางกายภาพของแต่ละคน ในร่างกายคนจะมีเซลล์อยู่ 2 ชนิดที่เกี่ยวข้องกับการรับสี คือ เซลล์รูปแท่งและเซลล์รูปโคน เซลล์รูปแท่งจะตอบสนองได้ดีกับการมองเห็นที่เกี่ยวกับความมืดสว่าง ส่วนเซลล์รูปโคนจะตอบสนองต่อที่มองเห็น


จากหลักการพื้นฐานเรื่องสีข้างต้น จึงได้มีการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดสีที่มีมาตรฐานและลดความไม่เป็นกลางเนื่องจากปัจจัยของแหล่งกำเนิดแสงและผู้สังเกตการณ์ องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานด้านสี คือ Commission International de' I Eclairage (CIE) หรือชื่อในอังกฤษว่า International Commission on Illumination (<http://www.cie.co.at/cie/>) องค์กรนี้ได้กำหนดมาตรฐานการวัดสีที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการวิชาการและการวิจัย คือ ระบบ CIE Lab scale ในระยะแรก CIE ได้กำหนดสเกลการวัดสีที่เป็น X-Y-Z ซึ่งใช้บรรยายสีเขียว (Green) สีแดง (Red) และสีน้ำเงิน (Blue) แต่เนื่องจากระบบสีดังกล่าวไม่สามารถบรรยายถึงความมืด - สว่าง ของสีได้ CIE ได้พัฒนาต่อมาเป็นระบบ X-Y-L ซึ่งบรรยายถึงค่าสีเขียว สีแดง และความสว่าง(lightness) ตามลำดับ อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวก็ยังคงขาดส่วนที่บรรยายถึงค่าสีน้ำเงิน CIE จึงได้พัฒนาระบบสีต่อมาจนเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ ระบบ $L^*-a^*-b^*$ ซึ่งเป็นระบบการบรรยายสีแบบ 3 มิติ โดยที่แกน L^* จะแสดงถึงความสว่าง (Lightness) จากค่า $+L^*$ แสดงถึงสีขาว จนถึง $-L^*$ แสดงถึงสีดำ แกน a^* จะบรรยายถึงแกนจากสีเขียว ($-a^*$) จนไปถึงสีแดง ($+a^*$) ส่วนแกน b^* จะบรรยายถึงแกนจากสีน้ำเงิน ($-b^*$) จนไปถึงสีเหลือง ($+b^*$) ลักษณะการบรรยายสีของ CIE แสดงได้ดังรูป 2.9 และ 2.10 นอกจากนี้บริษัท Hunter Lab จะใช้สเกล L-a-b บรรยายลักษณะสีเช่นเดียวกับ $L^*-a^*-b^*$ ของ CIE ข้อแตกต่างระหว่างระบบสีของ CIE และ Hunter Lab คือสูตรการคำนวณค่าสี ซึ่งทั้ง $L^*-a^*-b^*$ และ L-a-b ล้วนมีพื้นฐานการคำนวณมาจากระบบ X-Y-Z ทั้งสิ้น

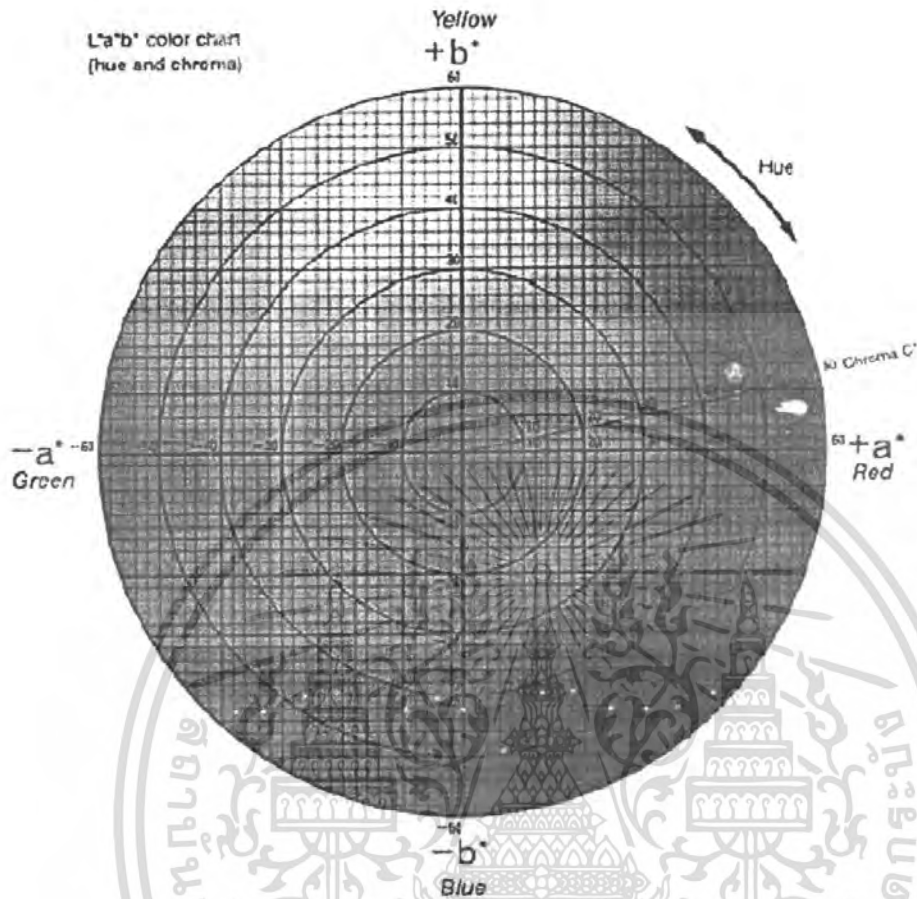

รูปที่ 2.9 การบรรยายสีในระบบ CIE Lab มองในระนาบ 2 มิติ : Hue บรรยายถึงเฉดสี Chroma บรรยายถึงความมันวาวหรือความเข้มของโทนสี

ที่มา : Minalta ,1997

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

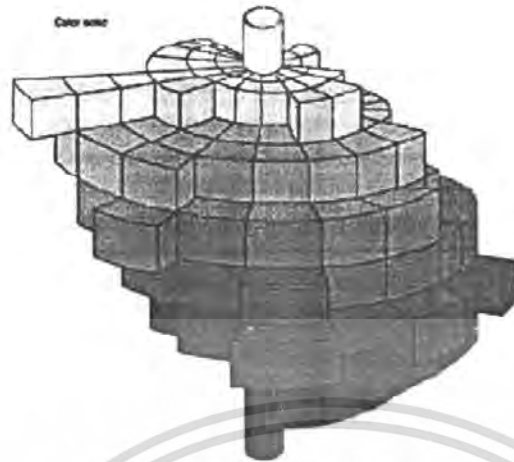

รูปที่ 2.10 การบรรยายสีพื้นในระบบ CIE Lab ในรูป 3 มิติ

ที่มา : Minolta , 1997

โดย L^* ใช้กำหนดค่าความสว่าง(Lightness)

$L=0$ = perfect black sample

$L=100$ = perfect white sample

a^* ใช้กำหนดสีแดงหรือสีเขียว

a เป็น + วัตถุมีสีออกแดง

a เป็น - วัตถุมีสีเขียว

b^* ใช้กำหนดสีเหลืองหรือสีฟ้า

b เป็น + วัตถุมีสีออกเหลือง

b เป็น - วัตถุมีสีออกน้ำเงิน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$\text{ซึ่ง } L^* = 116 (Y/Y_n)^{1/3} - 16$$

$$L^* = 500 ((X/X_n)^{1/3} - (Y/Y_n)^{1/3})$$

$$L^* = 200 ((Y/Y_n)^{1/3} - (Z/Z_n)^{1/3})$$

โดยที่ X_n, Y_n, Z_n คือค่า Tristimulus Value ของ Reference white ภายใต้ Illuminant หนึ่ง เช่น D65 ($Y_n = 100$ เสมอ ส่วน $X/X_n, Y/Y_n$ และ Z/Z_n จะมีค่ามากกว่า 0.01)

นอกจากนี้ในระบบ CIELAB ยังมีการปรับปรุงต่อไป โดยการเชื่อมค่า “a” และ “b” เข้ากับ “hue” และ “chroma” โดยกำหนด color term อีก 2 ตัว คือ hue angle (h^*) และ chroma (c^*)

Hue angle เป็นตัวเลขที่ระบุว่าสีมีตำแหน่งอยู่ที่ใดในกราฟ มีหน่วยเป็นองศา

$$\text{โดย } h^* = \tan^{-1} \left(\frac{b^*}{a^*} \right)$$

$$C^* = (a^{*2} + b^{*2})^{1/2}$$

ถ้า $h^* = 0^\circ$ แสดงว่าเป็น สีแดง

$h^* = 90^\circ$ แสดงว่าเป็น สีแดง

$h^* = 180^\circ$ แสดงว่าเป็น สีแดง

$h^* = 270^\circ$ แสดงว่าเป็น สีแดง

ส่วน Chroma จะได้จากความยาวของเส้นตรงจากจุดกำเนิดที่ $a^* = h^* = 0$ ไปยังตำแหน่งของตัวอย่าง C^* จะใช้บอกค่าความสดใสของสีที่ค่าความสว่างหนึ่งๆ

โดยทั่วไป ในการระบุสีของวัตถุมีสีในระบบ CIELAB นั้น มักจะระบุด้วยค่า L^*, C^* และ h^* มากกว่า L^*, a^* และ b^* เนื่องจากจะทำให้เข้าใจและทราบลักษณะของสีได้ใกล้เคียงกับที่ตาของมนุษย์มองเห็นสี

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

บทที่ 3

วัตถุดิบ อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

3.1 วัตถุดิบ

ตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใสที่ใช้ในการทดลอง


- 3.1.1 น้ำเขียวตราเฮลล์ลูบอย
- 3.1.2 น้ำแดงตราเฮลล์ลูบอย
- 3.1.3 น้ำส้มตราโกลแพน

3.2 อุปกรณ์

3.2.1 กล่องสี่เหลี่ยมที่ทำจากอะครีลิคหนา 4 มิลลิเมตร ความสูง 20 เซนติเมตร โดยมีขนาดดังต่อไปนี้

- พื้นที่หน้าตัด 10X10 ตารางเซนติเมตร
- พื้นที่หน้าตัด 12X12 ตารางเซนติเมตร
- พื้นที่หน้าตัด 14X14 ตารางเซนติเมตร
- พื้นที่หน้าตัด 16X16 ตารางเซนติเมตร

3.2.2 กล่องสี่เหลี่ยมที่ทำจากอะครีลิคใสหนา 2 มิลลิเมตร ความสูง 8 เซนติเมตร

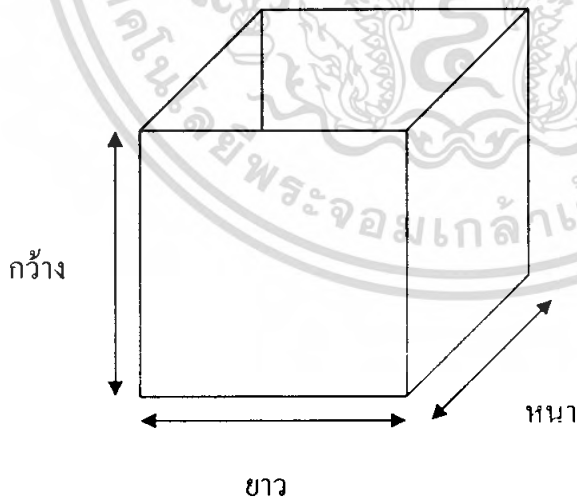

รูปที่ 3.1 แสดงลักษณะของกล่องสี่เหลี่ยมที่ออกแบบ

3.2.3 สติ๊กเกอร์พลาสติกสำหรับทำฉาก สีดำและสีขาว

3.2.4 เครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง(Minolta Colorimeter CR-300,Japan)

3.3 วิธีการทดลอง

3.3.1 ศึกษาปัจจัยของขนาดพื้นที่หน้าตัด ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส

3.3.1.1 ออกแบบภาชนะ

ออกแบบภาชนะบรรจุที่ใช้ในการทดลอง ให้มีความเหมาะสมกับเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง(Minolta Colorimeter CR-300,Japan) โดยกำหนดให้ภาชนะบรรจุเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทำจากอะครีลิกหนา 4 มิลลิเมตรมีขนาดดังนี้

- พื้นที่หน้าตัด 10X10 ตารางเซนติเมตร
- พื้นที่หน้าตัด 12X12 ตารางเซนติเมตร
- พื้นที่หน้าตัด 14X14 ตารางเซนติเมตร
- พื้นที่หน้าตัด 16X16 ตารางเซนติเมตร

3.3.1.2 กำหนดชนิดของอาหารเหลวโปร่งใสที่ใช้ในการทดลองได้แก่ น้ำแดง ที่ระดับความเข้มข้น 5%

3.3.1.3 กำหนดสีของฉากที่ใช้ในการวัดได้แก่ ฉากสีดำ(ค่า $L=0$)

3.3.1.4 ขั้นตอนการวัดสี

1. ติดสติ๊กเกอร์พลาสติกสีดำที่กั้นภาชนะซึ่งตรงข้ามกับหัววัดเพื่อทำเป็นฉาก
2. นำตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใสใส่ลงในภาชนะที่ออกแบบจนเต็มภาชนะ

(20 เซนติเมตร)

3. นำหัววัดของเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสงวางในแนวตั้งสัมผัสกับผิวหน้าของอาหารเหลวโปร่งใส

4. กดปุ่มที่เครื่องเพื่อวัดสี

5. บันทึกผลค่าสี L ,chroma และ hue โดยการวัด 3 ครั้งและหาค่าเฉลี่ย

6. ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนขนาดพื้นที่หน้าตัดของภาชนะบรรจุจนครบทุกขนาด

7. นำข้อมูลที่ได้จากการวัดสีไปวิเคราะห์ผลทางสถิติแบบกลุ่มสมบูรณ์(CRD)ด้วยโปรแกรม

SPSS version 11 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของค่าสี L ,chroma และ hue กับ

พื้นที่หน้าตัดขนาดต่างๆ ด้วย โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อดูว่าพื้นที่หน้าตัดแต่ละขนาดมีผลต่อ

ค่าการวัดสี L ,chroma และ hue หรือไม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.3.2 ศึกษาปัจจัยสีของฉลาก ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส

3.3.2.1 ออกแบบภาชนะ

ออกแบบภาชนะบรรจุที่ใช้ในการทดลอง ให้มีความเหมาะสมกับเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง (Minolta Colorimeter CR-300,Japan) โดยกำหนดให้ภาชนะบรรจุเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทำจากอะครีลิคหนา 4 มิลลิเมตรมีขนาดพื้นที่หน้าตัด 10X10 ตารางเซนติเมตร จำนวน 1 กล่อง

3.3.2.2 กำหนดสีฉลากที่ใช้ในการวัด

1. ฉลากสีขาว โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ

- ด้านข้างของภาชนะบรรจุโปร่งใส
- ด้านข้างของภาชนะบรรจุทึบแสง

2. ฉลากสีดำ โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะเช่นกันคือ

- ด้านข้างของภาชนะบรรจุโปร่งใส
- ด้านข้างของภาชนะบรรจุทึบแสง

3.3.2.3 กำหนดตัวอย่างของอาหารเหลวโปร่งใสที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ น้ำแดง น้ำเขียว และน้ำส้มที่ความเข้มข้น 100%

3.3.2.4 กำหนดระยะระหว่างหัววัดกับฉลากคือ 1,2,3,4,5,10,15 และ 20 เซนติเมตร

3.3.2.5 ขั้นตอนการวัดสี

1. นำตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใสใส่ลงในภาชนะขนาดพื้นที่หน้าตัด 10X10 ตารางเซนติเมตร ที่ได้ติดฉลากเรียบร้อยแล้ว
2. นำหัววัดของเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสงวางในแนวตั้งสัมผัสกับผิวหน้าของอาหารเหลวโปร่งใสที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉลากต่างๆ
3. กดปุ่มที่เครื่องเพื่อวัดสี
4. บันทึกผลค่าสี L,chroma และ hue โดยการวัด 3 ครั้งและหาค่าเฉลี่ย
5. ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนตัวอย่างของอาหารเหลวโปร่งใส สีของฉลาก(ด้านข้างภาชนะของบรรจุโปร่งใสและทึบแสง)และระยะระหว่างหัววัดกับฉลากจนครบตามที่กำหนด
6. นำข้อมูลที่ได้ไปสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าL,chroma และ hue กับระยะระหว่างหัววัดกับฉลากด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเปรียบเทียบผลของปัจจัยสีฉลากที่มีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส

3.3.3 ศึกษาอิทธิพลของระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่ 1-10 เซนติเมตรและระดับความเข้มข้น ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส

3.3.3.1 ออกแบบภาชนะ

ออกแบบภาชนะบรรจุที่ใช้ในการทดลอง ให้มีความเหมาะสมกับเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง(Minolta Colorimeter CR-300,Japan) โดยกำหนดให้ภาชนะบรรจุเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทำจากอะครีลิกหนา 4 มิลลิเมตรมีขนาดพื้นที่หน้าตัด 10X10 ตารางเซนติเมตร จำนวน 1 กล่อง

3.3.3.2 กำหนดสีของฉากที่ใช้วัด ได้แก่ ฉากสีขาว โดยให้ด้านข้างของภาชนะบรรจุมีลักษณะโปร่งใส

3.3.3.3 กำหนดตัวอย่างของอาหารเหลวโปร่งใสที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ น้ำแดง น้ำเขียว และน้ำส้ม

3.3.3.4 กำหนดระดับความเข้มข้นของอาหารเหลวที่ใช้ดังนี้ 5%,10%,20%,40%,60%,80% และ100%

3.3.3.5 กำหนดระยะระหว่างหัววัดกับฉากคือ 1,2,3,4,5, และ 15 เซนติเมตร

3.3.3.6 ขั้นตอนการวัดสี

1. นำตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใสที่ระดับความเข้มข้นต่างๆใส่ลงในภาชนะบรรจุขนาด 10X10 ตารางเซนติเมตร โดยติดฉากสีขาวที่กั้นภาชนะ ด้านข้างมีลักษณะโปร่งใส
2. นำหัววัดของเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสงวางในแนวตั้งสัมผัสกับผิวหน้าของอาหารเหลวโปร่งใสที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉากต่างๆ
3. กดปุ่มที่เครื่องเพื่อวัดสี
4. บันทึกผลค่าสี L,chroma และ hue โดยการวัด 3 ครั้งและหาค่าเฉลี่ย
5. ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใส ระยะระหว่างหัววัดกับฉากและระดับความเข้มข้นจนครบตามที่กำหนด
6. นำข้อมูลที่ได้อัปสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าL,chroma และ hue กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเปรียบเทียบผลของระยะระหว่างหัววัดกับฉากและระดับความเข้มข้นที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวหรือไม่

3.3.4 ศึกษาอิทธิพลของระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่ 0.2-10 เซนติเมตรและระดับความเข้มข้น ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลว โปร่งใส

3.3.4.1 ออกแบบภาชนะ

ออกแบบภาชนะบรรจุที่ใช้ในการทดลอง ให้มีความเหมาะสมกับเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง(Minolta Colorimeter CR-300,Japan) โดยกำหนดให้ภาชนะบรรจุเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทำจากอะครีลิกหนา 2 มิลลิเมตรมีขนาดพื้นที่หน้าตัด 8X8 ตารางเซนติเมตร จำนวน 1 กล่อง

3.3.4.2 กำหนดสีของฉากที่ใช้วัด ได้แก่ ฉากสีขาว โดยให้ด้านข้างของภาชนะบรรจุมีลักษณะโปร่งใส

3.3.4.3 กำหนดตัวอย่างของอาหารเหลวโปร่งใสที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ น้ำแดง น้ำเขียว และน้ำส้ม

3.3.4.4 กำหนดระดับความเข้มข้นของอาหารเหลวที่ใช้ดังนี้ 5%,10%,20%,40%,60%,80% และ100%

3.3.3.5 กำหนดระยะระหว่างหัววัดกับฉากคือ 0.2,0.4,0.6,0.8 และ 1 เซนติเมตร

3.3.3.6 ขั้นตอนการวัดสี

1. นำตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใสที่ระดับความเข้มข้นต่างๆใส่ลงในภาชนะบรรจุขนาด 8X8 ตารางเซนติเมตร โดยติดฉากสีขาวที่กั้นภาชนะ ด้านข้างมีลักษณะ โปร่งใส
2. นำหัววัดของเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสงวางในแนวตั้งสัมผัสกับผิวหน้าของอาหารเหลวโปร่งใสที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉากต่างๆ
3. กดปุ่มที่เครื่องเพื่อวัดสี
4. บันทึกผลค่าสี L,chroma และ hue โดยการวัด 3 ครั้งและหาค่าเฉลี่ย
5. ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนชนิดของอาหารเหลวโปร่งใส ระยะระหว่างหัววัดกับฉาก และระดับความเข้มข้นจนครบตามที่กำหนด
6. นำข้อมูลที่ได้ไปสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าL,chroma และ hue กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อเปรียบเทียบผลของระยะระหว่างหัววัดกับฉากและระดับความเข้มข้นที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวหรือไม่

บทที่ 4

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง


4.1 ศึกษาปัจจัยขนาดของพื้นที่หน้าตัด ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส

จากการศึกษาปัจจัยขนาดของพื้นที่หน้าตัด ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส นั้น ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.1 และเมื่อนำค่าที่ได้จากตารางที่ 4.1 มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า Lค่า chroma และค่า hue กับพื้นที่หน้าตัดโดยกำหนดตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใสและสีฉากไว้ พบว่าค่าเฉลี่ยของค่า Lค่า chroma และค่า hue มีค่าคงที่ขนาดพื้นที่หน้าตัด 10X10 ตารางเซนติเมตร 12X12 ตารางเซนติเมตร 14X14 ตารางเซนติเมตรและ 16X16 ตารางเซนติเมตร ดังนั้นขนาดของพื้นที่หน้าตัดจึง ไม่มีผลต่อค่าสีของอาหารเหลวโปร่งใสที่วัดในระบบ L a b จึงสามารถใช้ขนาดของพื้นที่หน้าตัดที่มีขนาดเล็กที่สุดได้นั้นก็คือที่ 10X10 ตารางเซนติเมตร อีกทั้งทำให้ปริมาตรของอาหารเหลวโปร่งใสที่ใช้ลดน้อยลงอีกด้วย


ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า chroma และค่า hue ของน้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 5% บรรจุในภาชนะที่ใช้พลาสติกด้านข้างมีลักษณะโปร่งใส ที่ขนาดพื้นที่หน้าตัดต่างๆ

ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตารางเซนติเมตร)	น้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 5% (ในภาชนะที่ใช้พลาสติกด้านข้างมีลักษณะโปร่งใส)		
	Lเฉลี่ย	chromaเฉลี่ย	hueเฉลี่ย
10X10	12.61	16.67	301
12X12	12.65	16.64	300.6
14X14	12.74	16.42	300.7
16X16	12.67	15.96	300.7

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

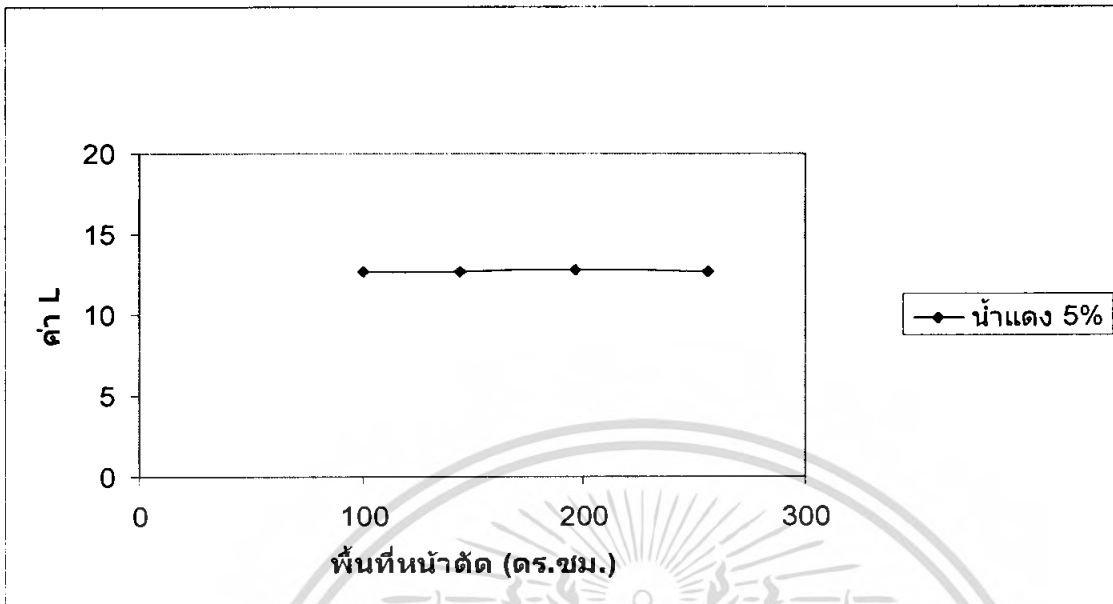


รูปที่ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า L กับพื้นที่หน้าตัดของน้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 5% บรรจุในภาชนะที่ใช้ฉลากสีดำด้านข้างมีลักษณะโปร่งใส

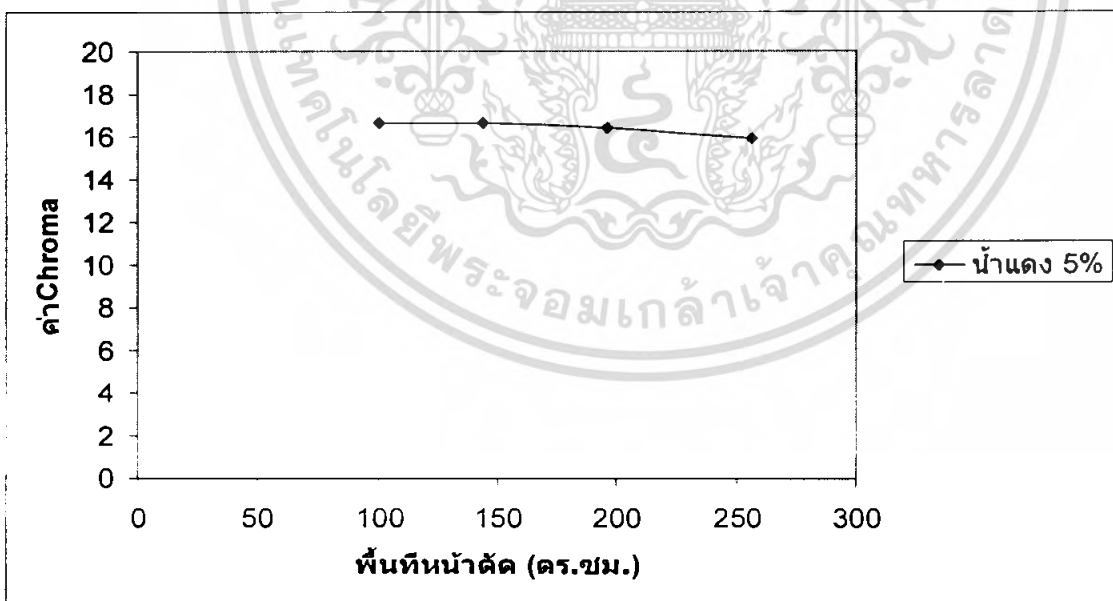

รูปที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า chroma กับพื้นที่หน้าตัดของน้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 5% บรรจุในภาชนะที่ใช้ฉลากสีดำด้านข้างมีลักษณะโปร่งใส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

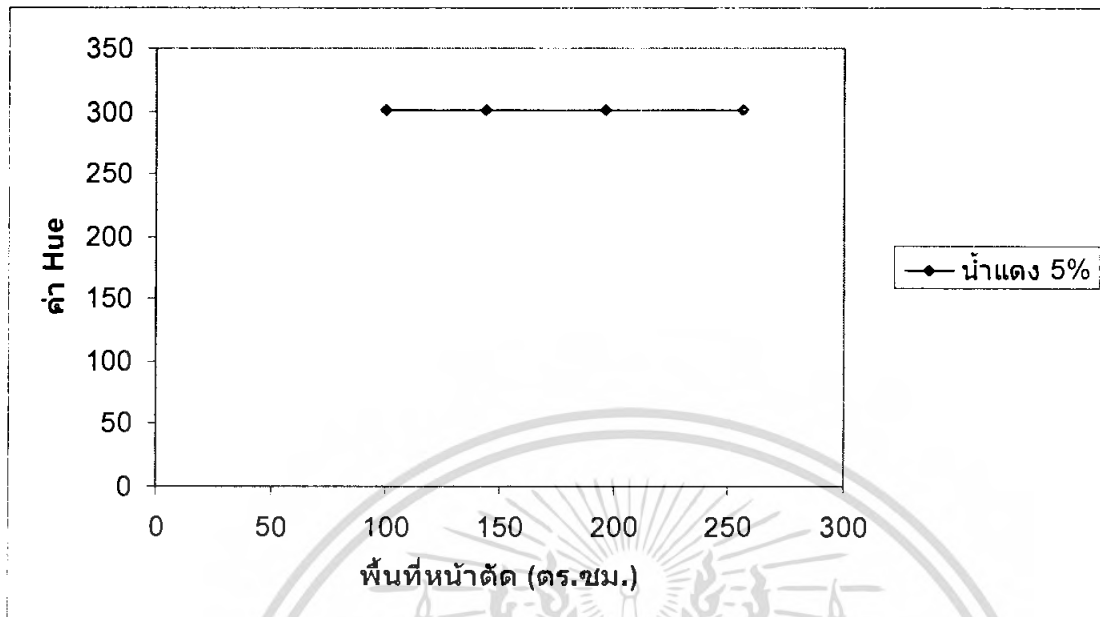

รูปที่ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า hue กับพื้นที่หน้าตัดของน้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 5% บรรจุในภาชนะที่ใช้จากสีดำด้านข้างมีลักษณะโปร่งใส

4.2 ศึกษาปัจจัยสีของฉาก ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส

จากการศึกษาปัจจัยสีของฉากที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.2 เมื่อนำค่าในตารางมาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า chroma และค่า hue กับระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่ 1,2,3,4,5,10,15 และ 20 เซนติเมตร ของตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใส 3 ชนิดคือ น้ำแดง น้ำเขียวและน้ำส้ม ที่ระดับความเข้มข้น 100% โดยใช้กล่องอะคริลิกที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัด 10X10 ตารางเซนติเมตร พบว่า กล่องอะคริลิกที่ใช้ฉากสีขาว ซึ่งด้านข้างของภาชนะมีลักษณะโปร่งใสและทึบแสงนั้น ให้ค่าการวัดสีอาหารเหลวโปร่งใสได้ถูกต้องทั้ง 3 ตัวอย่าง ดังนั้นจึงเลือกใช้ฉากสีขาวซึ่งด้านข้างของภาชนะมีลักษณะโปร่งใส ทำให้สามารถมองเห็นระยะระหว่างหัววัดกับฉากได้ชัดเจนและได้ระยะที่ถูกต้องและแน่นอนขณะทำการวัด



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า chroma และค่า hue ของน้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 100% ที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉลากและสีของฉลากต่างๆ

ฉลาก	ระยะระหว่างหัววัดกับ ฉลาก (เซนติเมตร)	น้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 100%		
		Lเฉลี่ย	chromaเฉลี่ย	hueเฉลี่ย
ขาว (ด้านข้างโปร่งใส)	1	19.66	29.73	351.3
	2	16.11	20.22	329.5
	3	15.73	16.8	316
	4	15.05	16.17	310.1
	5	14.62	16.19	307.3
	10	14.42	15.71	302.2
	15	14.35	15.5	301.4
	20	14.45	15.58	301.5
ขาว (ด้านข้างทึบแสง)	1	22.24	29.58	354.6
	2	17.65	21.11	335
	3	15.71	17.24	318.3
	4	14.93	16.79	312.5
	5	15.54	15.62	309.3
	10	14.22	15.54	302.5
	15	14.49	15.42	301.8
	20	14.32	15.22	300.7
ดำ (ด้านข้างโปร่งใส)	1	16.13	16.06	301
	2	16.16	15.28	299
	3	15.89	15.78	298.6
	4	15.9	15.79	298.6
	5	15.9	15.79	298.3
	10	15.84	15.9	298.2
	15	15.73	15.74	298
	20	15.88	15.91	298.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า chroma และค่า hue ของน้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 100% ที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉากและสีของฉากต่างๆ(ต่อ)

ฉาก	ระยะระหว่างหัววัดกับฉาก (เซนติเมตร)	น้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 100%		
		Lเฉลี่ย	chromaเฉลี่ย	hueเฉลี่ย
ค่า (ด้านข้างที่บแสง)	1	14.51	14.95	302.4
	2	14.95	15.27	301.8
	3	14.02	15.09	301.1
	4	14.14	14.83	302.1
	5	14.23	14.41	301.6
	10	14.46	14.72	301.9
	15	13.99	14.83	300.5
	20	14.28	14.87	300.6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า chroma และค่า hue ของน้ำเขียวที่ระดับความเข้มข้น 100% ที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉากและสีของฉากต่างๆ

ฉาก	ระยะระหว่างหัววัดกับ ฉาก (เซนติเมตร)	น้ำเขียวที่ระดับความเข้มข้น 100%		
		Lเฉลี่ย	chromaเฉลี่ย	hueเฉลี่ย
ขาว (ด้านข้างโปร่งใส)	1	23.21	16.67	178.9
	2	16.72	10.96	287.8
	3	15.84	13.47	297.6
	4	15.45	14.34	300
	5	15.5	14.41	300.1
	10	15.01	14.93	300.8
	15	14.98	15.15	300.9
	20	14.93	15.33	301.3
ขาว (ด้านข้างทึบแสง)	1	28.73	32.85	159.7
	2	15.59	10.51	285.5
	3	15.19	12.61	296.5
	4	14.86	12.81	297.8
	5	15.43	12.46	297.8
	10	14.58	13.82	299.5
	15	14.09	14.42	300
	20	13.74	14.84	300.7
ดำ (ด้านข้างโปร่งใส)	1	16.17	14.98	295.7
	2	16.02	15.33	297.2
	3	15.87	15.47	297.7
	4	15.88	15.65	297.7
	5	15.89	15.68	297.5
	10	15.78	15.46	297.5
	15	15.91	15.63	297.8
	20	14.07	15.28	300.5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า chroma และค่า hue ของน้ำเขียวที่ระดับความเข้มข้น 100% ที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉากและสีของฉากต่างๆ(ต่อ)

ฉาก	ระยะระหว่างหัววัดกับฉาก (เซนติเมตร)	น้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 100%		
		Lเฉลี่ย	chromaเฉลี่ย	hueเฉลี่ย
ค่า (ด้านข้างที่บแสง)	1	14.06	14.06	297.9
	2	13.06	14.82	300.2
	3	14.12	14.44	300.1
	4	13.54	15.05	300.3
	5	13.87	14.63	300.3
	10	13.85	14.77	300.7
	15	13.64	14.83	300.1
	20	13.7	15.23	300.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า chroma และค่า hue ของน้ำส้มที่ระดับความเข้มข้น 100% ที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉากและสีของฉากต่างๆ


ฉาก	ระยะระหว่างหัววัดกับ ฉาก (เซนติเมตร)	น้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 100%		
		Lเฉลี่ย	chromaเฉลี่ย	hueเฉลี่ย
ขาว (ด้านข้างโปร่งใส)	1	36.5	25.74	68.3
	2	36.05	25.17	68.1
	3	36.11	25.11	68.7
	4	36.06	25.09	68.9
	5	36.06	25.01	68.9
	10	36.15	25.04	69.2
	15	36.09	25.06	69
	20	36.02	25.07	68.7
ขาว (ด้านข้างทึบแสง)	1	36.62	31.33	70.6
	2	36.24	24.84	68.47
	3	36.14	25.38	68.7
	4	36.17	23.77	68.1
	5	35.98	25.2	68.7
	10	36.02	25.16	68.6
	15	36.04	25.17	68.7
	20	35.94	25.19	68.7
ดำ (ด้านข้างโปร่งใส)	1	34.96	21.82	70.6
	2	35.77	24.25	69.3
	3	36.05	24.73	69
	4	36.06	24.81	68.8
	5	35.97	24.72	68.6
	10	36.07	24.72	68.6
	15	36.03	24.74	68.7
	20	36.02	24.83	68.5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า chroma และค่า hue ของน้ำส้มที่ระดับความเข้มข้น 100% ที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉากและสีของฉากต่างๆ(ต่อ)

ฉาก	ระยะระหว่างหัววัดกับฉาก (เซนติเมตร)	น้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 100%		
		Lเฉลี่ย	chromaเฉลี่ย	hueเฉลี่ย
ค่า (ด้านข้างที่บแสง)	1	34.72	21.72	70.1
	2	35.84	24.41	69.3
	3	36.09	24.86	69.1
	4	36.24	24.56	68.7
	5	36.29	23.61	68.4
	10	36.34	24.61	68.6
	15	36.36	22.4	67.5
	20	36.41	22.21	67.4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

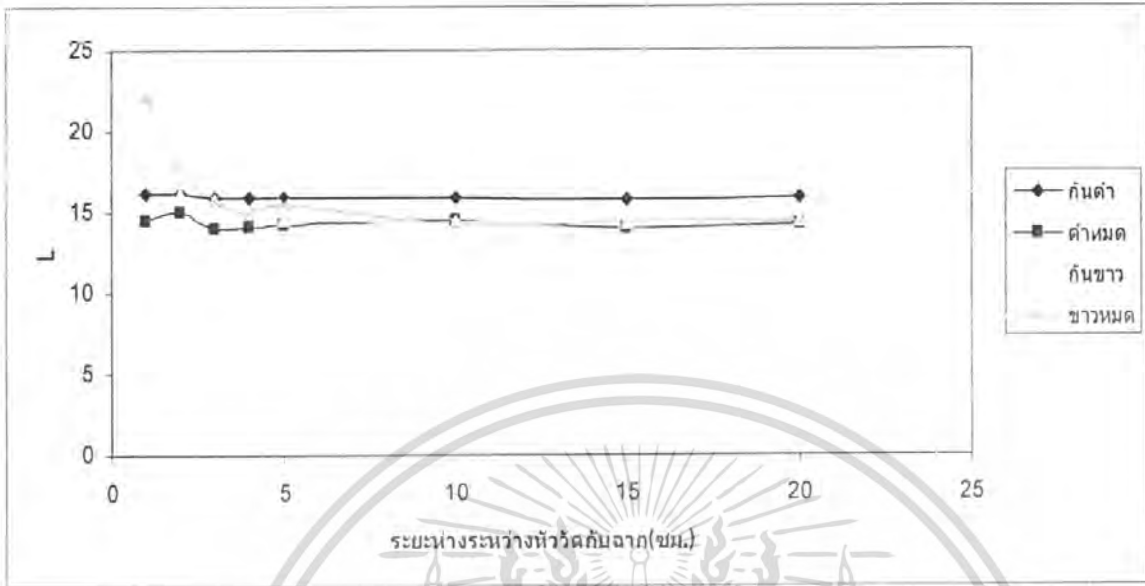


รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า L* กับระยะระหว่างหัววัดกับฉาก ที่สีฉากต่างๆ ของน้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 100%

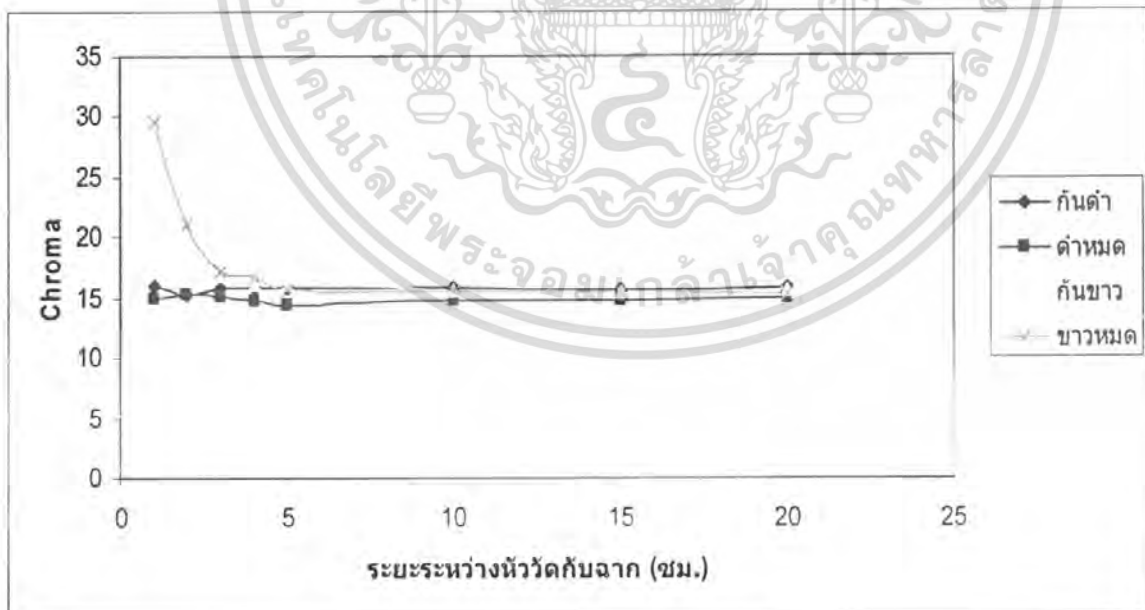


รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า chroma กับระยะระหว่างหัววัดกับฉาก ที่สีฉากต่างๆ ของน้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 100%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

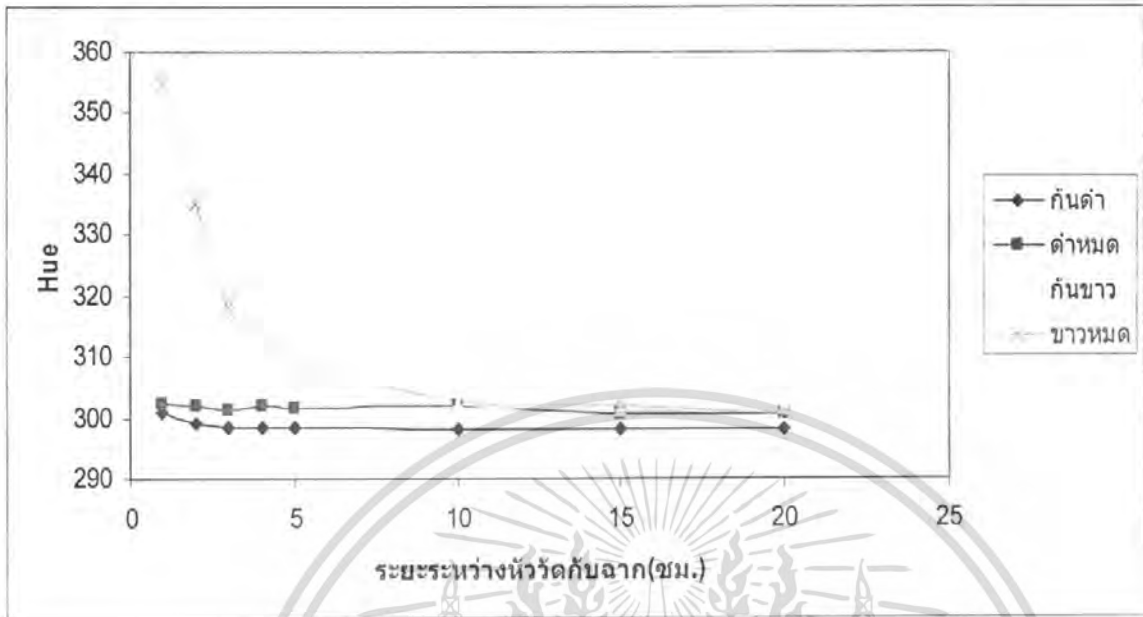


รูปที่ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า hue กับระยะระหว่างหัววัดกับฉาก ที่สี
 ฉากต่างๆ ของน้ำแดงที่ระดับความเข้มข้น 100%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

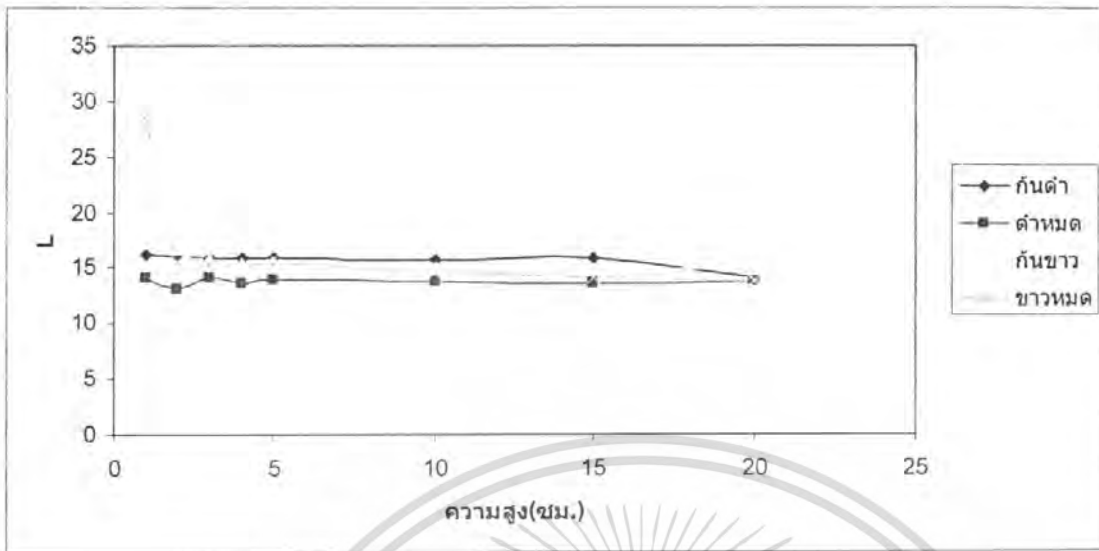


รูปที่ 4.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า L* กับระยะระหว่างหัววัดกับฉาก ที่สีฉากต่างๆ ของน้ำเขียวที่ระดับความเข้มข้น 100%

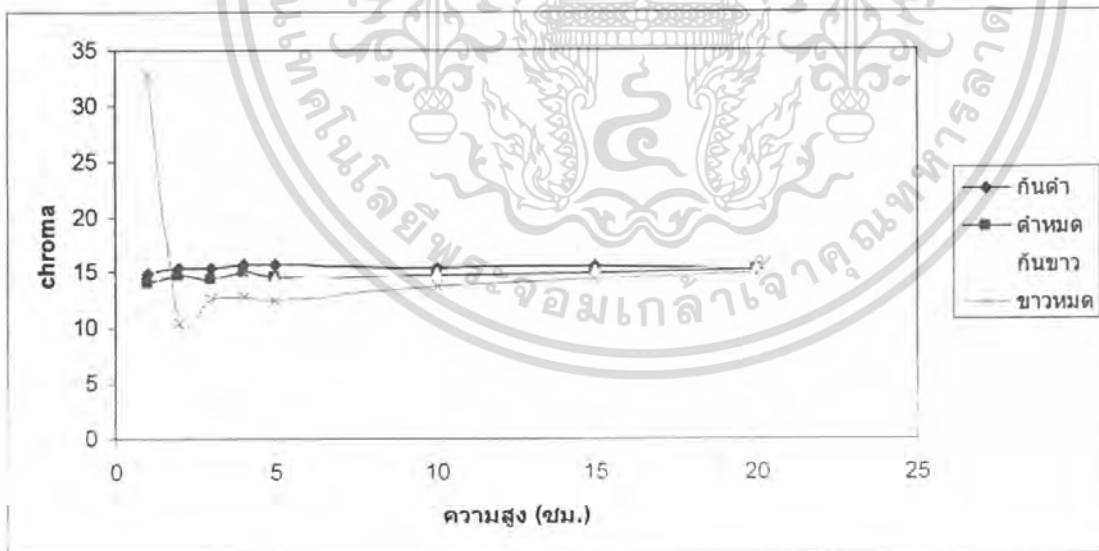


รูปที่ 4.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า chroma กับระยะระหว่างหัววัดกับฉาก ที่สีฉากต่างๆ ของน้ำเขียวที่ระดับความเข้มข้น 100%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

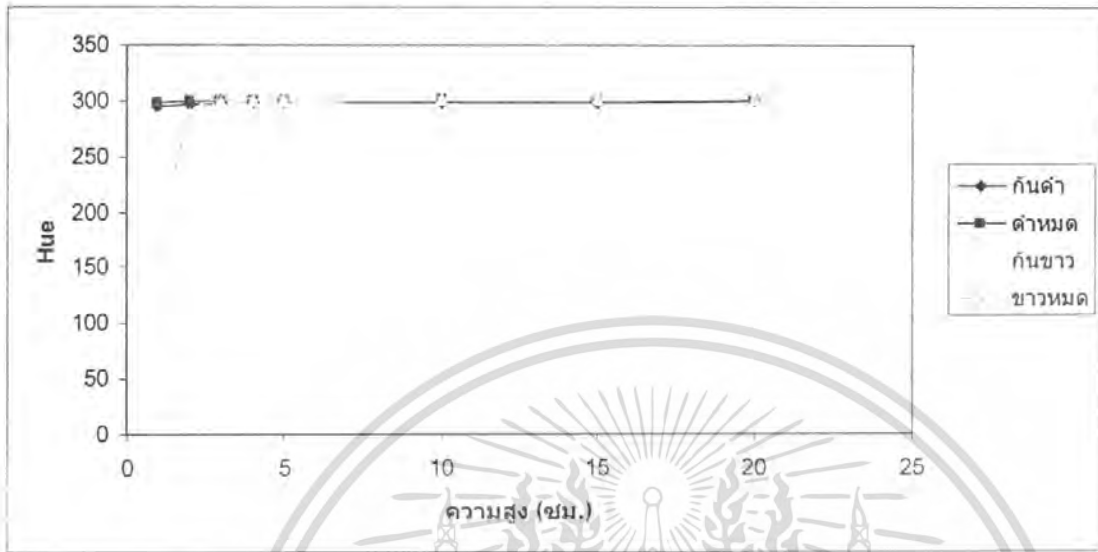


รูปที่ 4.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า hue กับระยะระหว่างหัววัดกับฉาก ที่สี
ฉากต่างๆ ของน้ำเขียวที่ระดับความเข้มข้น 100%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

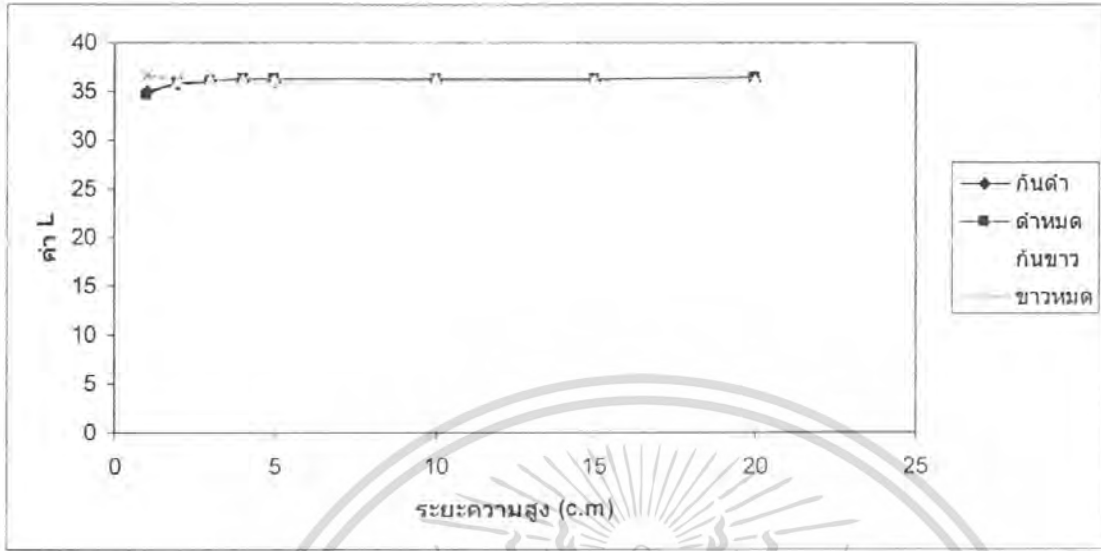


รูปที่ 4.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า L กับระยะระหว่างหัววัดกับฉาก ที่สีฉากต่างๆ ของน้ำส้มที่ระดับความเข้มข้น 100%

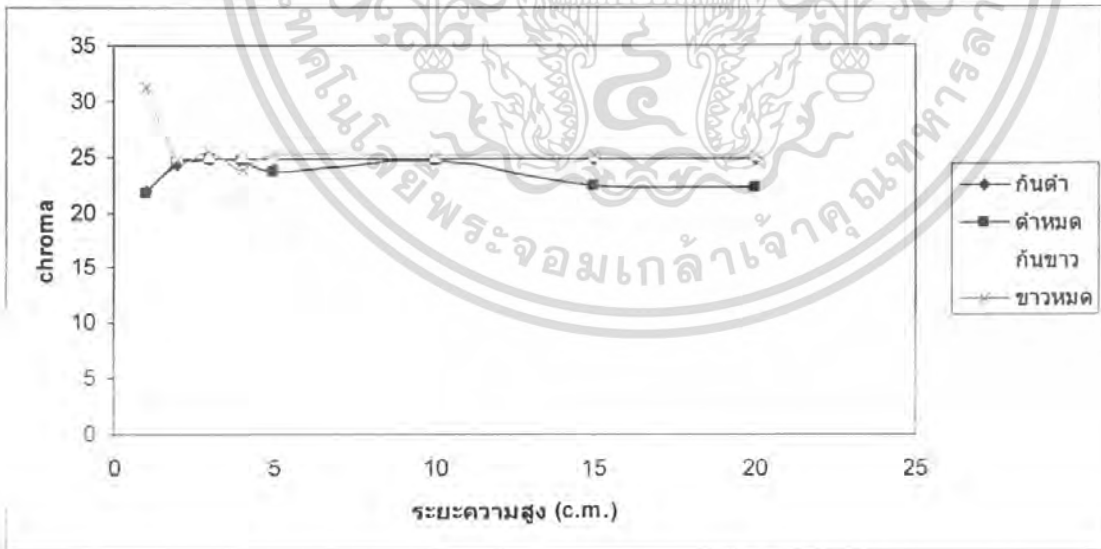

รูปที่ 4.11 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า chroma กับระยะระหว่างหัววัดกับฉาก ที่สีฉากต่างๆ ของน้ำส้มที่ระดับความเข้มข้น 100%

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

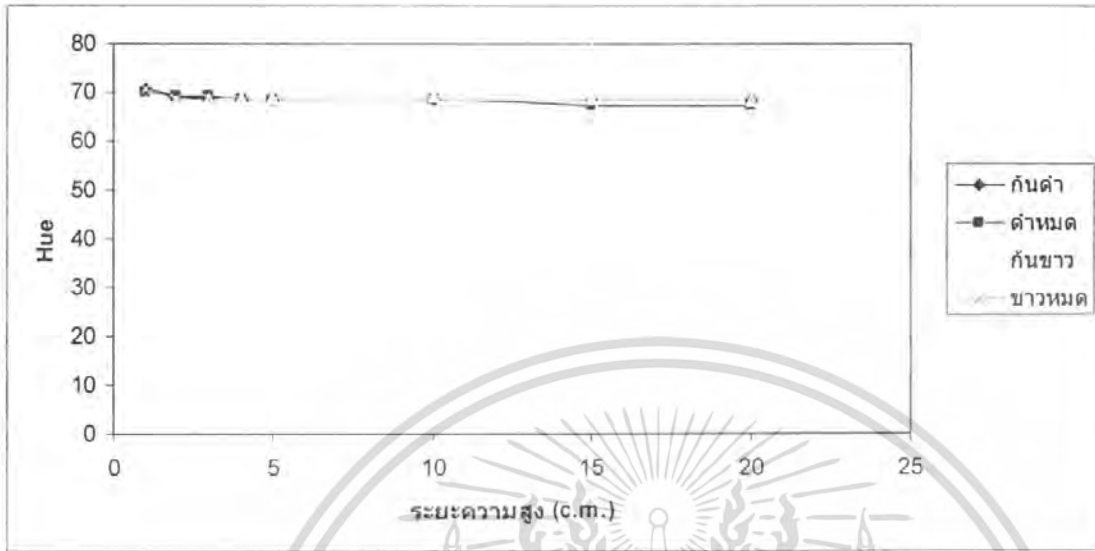

รูปที่ 4.12 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า hue กับระยะระหว่างหัววัดกับฉาก ที่
 ใจฉากต่างๆ ของน้ำส้มที่ระดับความเข้มข้น 100%



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.3 ศึกษาปัจจัยของระยะจากหัววัดจนถึงฉากช่วง 1 – 10 เซนติเมตร ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัด สีของอาหารเหลวโปร่งใส

จากรูป 4.12 , 4.13 และ 4.14 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดจนถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ L, chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์ลูบอย ที่ทุกๆความเข้มข้น พบว่า ค่า L หรือค่าความสว่างของสีนั้น เมื่อเพิ่มระยะจากหัววัดถึงฉากจาก 1 เซนติเมตร เป็น 2 เซนติเมตร จะทำให้ค่า L ลดลง นั่นคือสีมีความสว่างลดลงทุกๆความเข้มข้น และเมื่อเพิ่มระยะเพิ่มขึ้นอีก พบว่า ค่า L ไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เส้นกราฟที่ได้จึงเป็นเส้นตรงที่ทุกความเข้มข้น ค่า Chroma หรือค่าความเข้มสีของตัวอย่าง เมื่อเพิ่มระยะวัดจาก 1 เป็น 2 เซนติเมตร พบว่า ค่า Chroma ลดลงค่อนข้างชัดเจนที่ความเข้มข้นสูงๆ แต่ที่ความเข้มข้นต่ำๆจะลดลงไม่มากนัก นั่นคือ เมื่อเพิ่มระยะวัดจาก 1 เป็น 2 เซนติเมตร จะทำให้สีอ่อนลงเมื่อเพิ่มจาก 2 เซนติเมตร เป็นต้นไป พบว่าค่า Chroma ค่อนข้างคงที่ นั่นคือสีมีความเข้มสีเท่าเดิม สำหรับ ค่า Hue ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกสีของตัวอย่าง ดังนั้นผลของค่าดังกล่าวจึงมีความสำคัญมากในระบบการวัดสีนี้ ผลจากการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มระยะวัดจาก 1 เป็น 2 เซนติเมตร สีที่ได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 350 – 10 องศา แต่เมื่อเพิ่มระยะขึ้นจาก 2 เซนติเมตร เป็นต้นไป ค่าสีที่ได้ก็ผิดเพี้ยนไปเป็นสีน้ำเงิน

จากรูป 4.15 , 4.16 และ 4.17 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดจนถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ L, chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์ลูบอย ที่ทุกๆความเข้มข้น พบว่า ค่า L หรือค่าความสว่างของสีนั้น มีแนวโน้มเดียวกับตัวอย่างน้ำแดง นั่นคือ เมื่อเพิ่มระยะจากหัววัดถึงฉากจาก 1 – 2 เซนติเมตร จะทำให้ค่า L ลดลง สีมีความสว่างลดลงที่ทุกๆ ความเข้มข้น และเมื่อเพิ่มระยะขึ้น พบว่าค่า L ไม่เปลี่ยนแปลงกราฟที่ได้เป็นเส้นตรงทุกความเข้มข้น ค่า Chroma หรือค่าความเข้มสี ก็มีแนวโน้มเช่นเดียวกับตัวอย่างน้ำแดงคือ เมื่อเพิ่มระยะจาก 1-2 เซนติเมตร ค่า Chroma จะลดลง ที่ความเข้มข้นสูงๆ แต่เมื่อความเข้มข้นลดลงค่า Chroma จะลดลงด้วยเช่นกัน แต่ให้ค่าไม่ชัดเจนนัก ซึ่งสีจะอ่อนลงเมื่อค่าความเข้มข้นสูงจะได้ค่า Chroma มาก สีจึงเข้มขึ้นกว่าตัวอย่างที่มีความเข้มข้นต่ำ สำหรับระยะที่ 2 เซนติเมตร เป็นต้นไป ค่า Chroma จะคงที่ สำหรับค่า Hue พบว่า ที่ 1 เซนติเมตร จะได้ค่าอยู่ในช่วง 137 – 179 องศา ซึ่งเป็นค่าของสีเขียวแต่เมื่อเพิ่มระยะขึ้นไปเรื่อยๆ ค่าสีที่เครื่องวัด วัดได้จะให้สีที่ผิดเพี้ยนไปได้สีที่อยู่ในช่วงสีน้ำเงินซึ่งไม่ใช่ค่าสีของตัวอย่างที่ปรากฏออกมา

และจากรูป 4.18 , 4.19 และ 4.20 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตรา โกลด์แพนที่ทุกๆความเข้มข้น พบว่าค่า L เมื่อเพิ่มระยะการวัดจาก 1 เป็น 2 เซนติเมตร จะทำให้ค่า L ที่ได้ลดลงมีผลทำให้ค่าความสว่างลดลง และถ้าเพิ่มระยะการวัดมากขึ้นเรื่อยๆ ค่าความสว่างของสีนี้จะมีค่าคงที่ ค่า

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาติให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Chroma หรือค่าความเข้มสี พบว่าที่ระยะที่ 1-2 เซนติเมตร ค่า Chroma จะลดลง มีผลให้ความเข้มสีลดลง ที่ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น ค่า Chroma จะเพิ่มขึ้น ในทางเดียวกันเมื่อความเข้มข้นลดลง ค่า Chroma ก็จะลดลงไปด้วย เมื่อวัดที่ 2 เซนติเมตร เป็นต้นไป ค่าความเข้มสีนี้จะไม่เปลี่ยนแปลง ที่ทุกความเข้มข้น

สำหรับค่า Hue เนื่องจากตัวอย่างของน้ำส้มที่นำมาวัดค่อนข้างมีความขุ่น เมื่อวัดค่าสีต่างๆ พบว่าระยะจากหัววัดถึงฉาก ไม่มีผลต่อค่าสีที่ได้ นั่นคือ ไม่ว่าจะเพิ่มระยะจาก 1 จนถึง 10 เซนติเมตร ค่า Hue ที่ได้จะอยู่ในช่วง 67 – 94 องศา ซึ่งเป็นสีน้ำเงิน ที่ความเข้มข้นมากที่สุดจนถึงความเข้มข้นที่ 20% แต่ที่ความเข้มข้น 5% และ 10% เมื่อวัดค่า Hue จะได้ค่าที่ผิดพลาดเมื่อวัดที่ระยะตั้งแต่ 3 เซนติเมตร เป็นต้นไป จะได้ค่าอยู่ในช่วง 300 – 358 องศา ซึ่งเป็นค่าของสีแดง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์บลู๊บล้อย
เข้มข้น ที่ระยะจากหัววัดถึงฉลากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉลาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	19.66	29.73	351.3
2	16.11	20.22	329.5
3	15.73	16.8	316
4	15.05	16.17	310.1
5	14.62	16.19	307.3
10	14.42	15.71	302.2

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์บลู๊บล้อย
ความเข้มข้น 80 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉลากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉลาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	18.71	29.66	356.5
2	14.32	18.64	329.9
3	13.61	16.61	320.3
4	13.36	15.2	312.6
5	12.99	15.02	308.9
10	12.82	14.39	302.8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L, Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดงตราเฮลล์บลู๊บล้อย ความเข้มข้น 60 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hueเฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	18.77	28.89	357.5
2	14.39	18.54	332
3	13.53	16.51	321.5
4	13.12	15.43	314.3
5	12.88	14.66	309.1
10	12.61	14.27	303.2

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L, Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดงตราเฮลล์บลู๊บล้อย ความเข้มข้น 40 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	Lเฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	20.44	31.36	363.4 (3.4)
2	14.88	19.27	337.2
3	13.51	16.32	322.8
4	13.03	15.21	315.3
5	12.69	14.77	309.8
10	12.44	14.21	304.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดงตราเสถียรบลู๊บล้อย ความเข้มข้น 20 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hueเฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	24.15	34.38	370.7(10.7)
2	16.36	20.81	346.4
3	13.87	16.16	322.8
4	13.36	15.37	318.9
5	12.88	14.86	312.5
10	12.48	14.16	305

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดงตราเสถียรบลู๊บล้อย ความเข้มข้น 10 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ


ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hueเฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	27.59	32.97	370.2(10.2)
2	17.03	20.04	347.9
3	14.71	16.32	330.5
4	13.88	15.36	321.1
5	13.33	14.58	313.5
10	12.75	14	305.6

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์บูล์บอย ความเข้มข้น 5 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	Lเฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hueเฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	30.78	25.45	365.6(5.6)
2	16.78	19.48	350
3	15.4	16.2	334.3
4	14.51	15.07	324.6
5	15.56	13.57	315.9
10	12.74	13.72	305.1

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

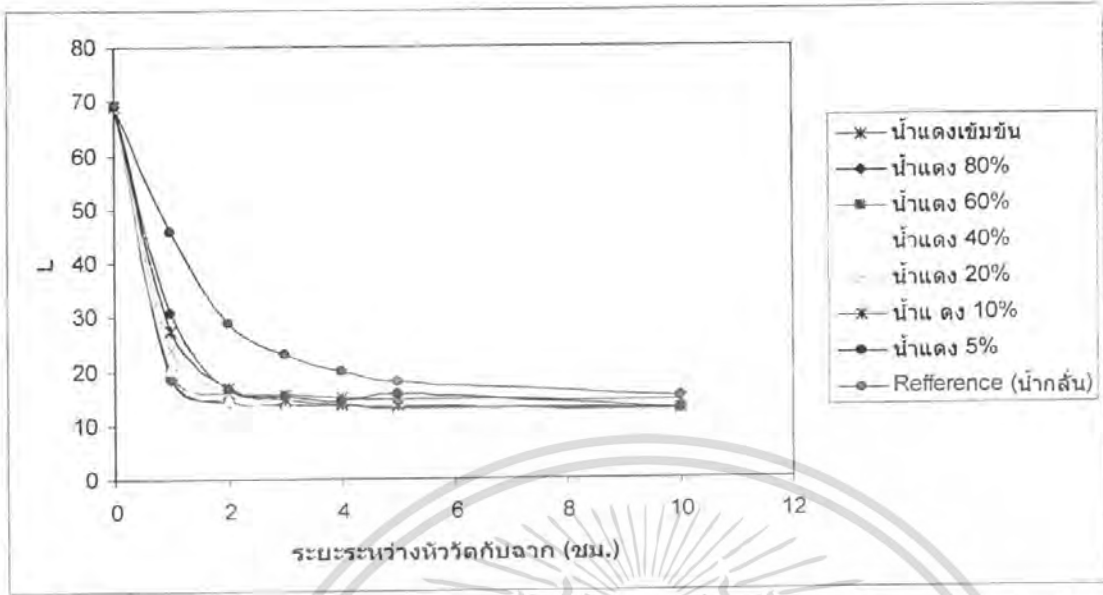


รูปที่ 4.13 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ L ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์ลูบอย ที่ทุกๆความเข้มข้น

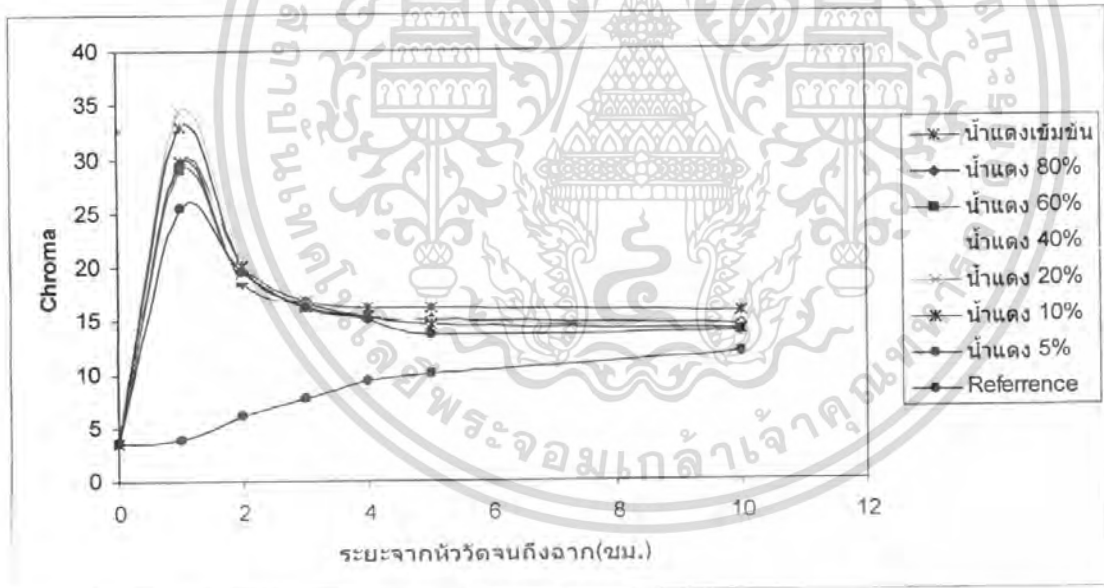

รูปที่ 4.14 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ Chroma ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์ลูบอย ที่ทุกๆความเข้มข้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

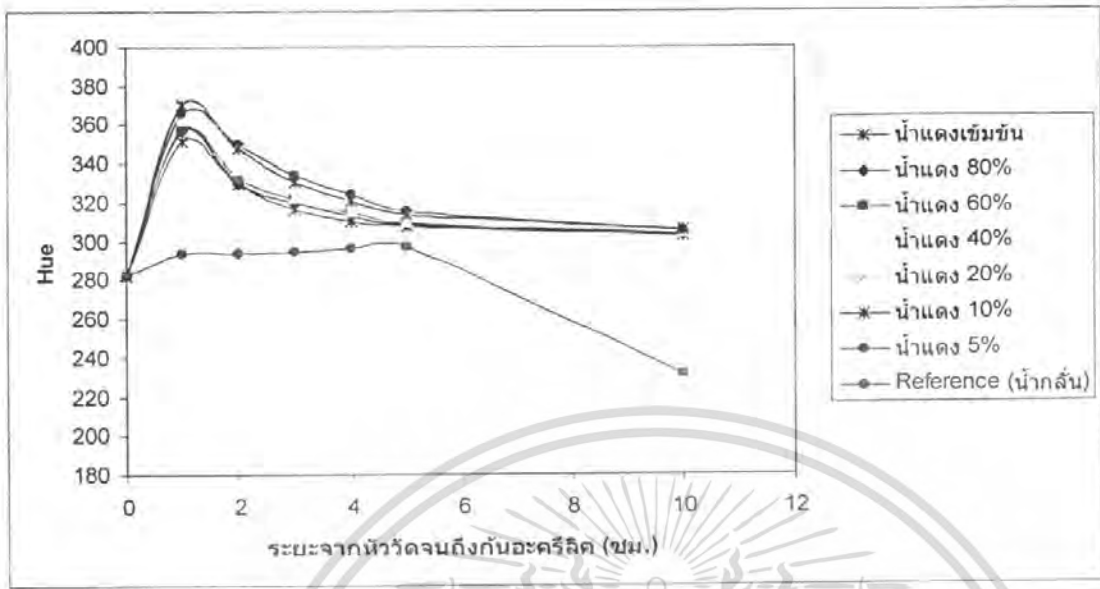

รูปที่ 4.15 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์บอย ที่ทุกๆ ความเข้มข้น



ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บลอย
เข้มข้น ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	Lเฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue bar
0	69.16	3.56	282.4
1	23.21	16.67	178.9
2	16.72	10.96	287.8
3	15.84	13.47	297.6
4	15.45	14.34	300
5	15.5	14.41	300.1
10	15.01	14.93	300.8

ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บลอย
ความเข้มข้น 80 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	Lเฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hueเฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	29.43	35.41	159.4
2	15.74	8.6	265.4
3	13.81	12.96	294.5
4	13.38	14.17	298.6
5	13.34	14.36	299.2
10	13.16	14.8	299.9

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลูบอย ความเข้มข้น 60 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	30.2	35.87	157.5
2	16.85	7.93	237
3	14.45	10.85	285.2
4	13.57	13.07	295.2
5	13.22	13.99	298.2
10	13.02	14.52	299.7

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลูบอย ความเข้มข้น 40 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hueเฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	33.43	37.45	151.8
2	17.58	8.18	218.3
3	14.76	9.66	278.4
4	13.87	11.7	290.3
5	13.28	13.17	296.2
10	12.94	14.21	299.00

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลูส์บอย ความเข้มข้น 20 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	37.59	34.33	144.1
2	20.75	11.72	181.2
3	16.1	7.51	254.5
4	14.91	9.14	276.00
5	13.86	11.44	298.5
10	12.93	13.73	298.4

ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลูส์บอย ความเข้มข้น 10 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ


ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	42.24	27.00	137.2
2	22.42	10.37	172.8
3	18.44	6.46	216.0
4	16.35	6.94	256.4
5	14.96	9.05	279.6
10	13.2	5.74	296.2

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้


ตารางที่ 4.18 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บบอย ความเข้มข้น 5 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	44.76	17.04	136.5
2	26.27	9.85	155.2
3	19.85	4.86	212.8
4	18.06	5.48	247.7
5	15.87	8.22	277.6
10	13.83	12.15	293.8

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

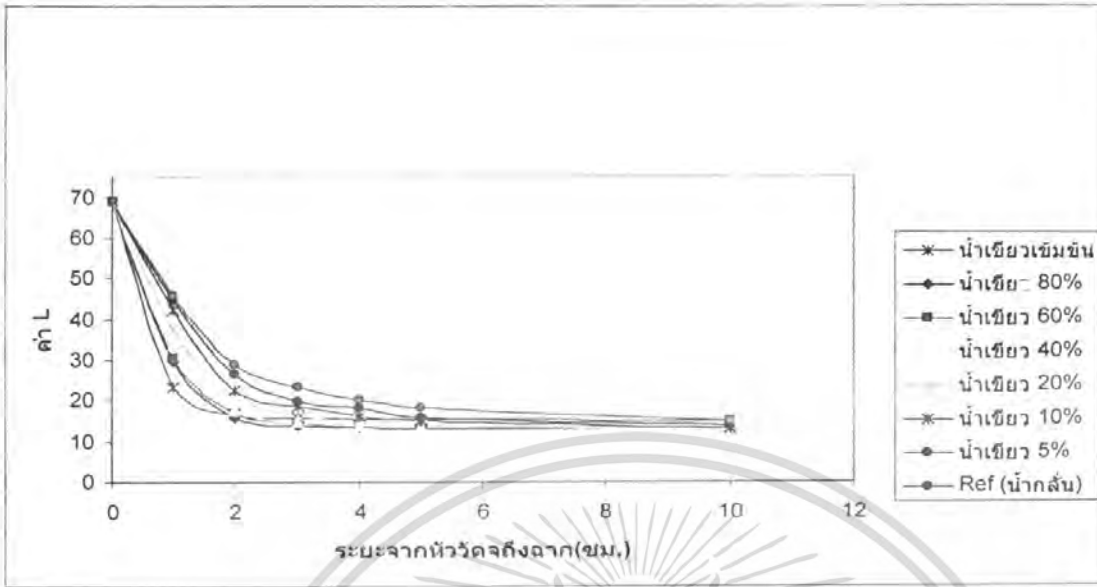

รูปที่ 4.16 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ L ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลูบอย ที่ทุกๆความเข้มข้น

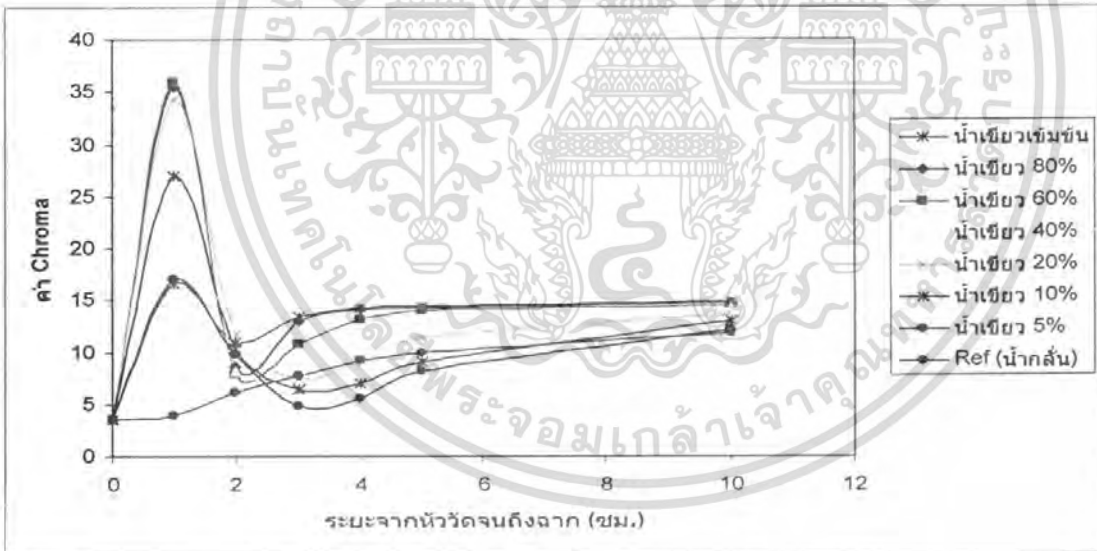

รูปที่ 4.17 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ Chroma ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลูบอย ที่ทุกๆความเข้มข้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.19 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้ม ตราโกลด์แพช เข้มข้น ที่ระยะจากหัววัดถึงฉลากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉลาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	37.75	25.4	67.5
2	37.02	24.6	67.7
3	37.08	24.72	68.1
4	37.06	24.74	68.2
5	37.06	24.7	68.2
10	37.1	24.64	68.3

ตารางที่ 4.20 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บลอย ความเข้มข้น 80 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉลากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉลาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	36.76	24.11	69.1
2	35.76	21.91	69.2
3	35.71	21.86	69.4
4	35.73	21.83	69.4
5	35.72	21.86	69.5
10	35.73	21.04	69.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.21 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บลอย ความเข้มข้น 60 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	35.58	21.09	70.4
2	33.83	18.03	70.3
3	33.69	17.69	70.7
4	33.63	17.63	70.9
5	33.62	17.55	70.7
10	33.64	17.52	71.1

ตารางที่ 4.22 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บลอย ความเข้มข้น 40 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	35.62	20.84	73
2	30.87	12.5	69.93
3	30.45	11.74	69.8
4	30.4	11.64	70
5	30.38	11.38	70.6
10	30.31	11.4	70.4

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.23 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บบอย ความเข้มข้น 20 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	36.99	22.1	80.8
2	26.64	6.11	53
3	25.42	4.18	41.4
4	25.06	3.54	35.9
5	24.86	3.3	32.7
10	24.8	3.06	31.1


ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บบอย ความเข้มข้น 10 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	42.32	22	89.4
2	26.44	6.26	56.2
3	23.12	3.84	354.6
4	21.84	4.37	325.3
5	21.42	4.82	317.6
10	20.8	5.28	307.6


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บบอย ความเข้มข้น 5 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ


ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	69.16	3.56	282.4
1	42.32	22	89.4
2	26.44	6.26	56.2
3	23.12	3.84	354.6
4	21.84	4.37	325.3
5	21.42	4.82	317.6
10	20.8	5.28	307.6

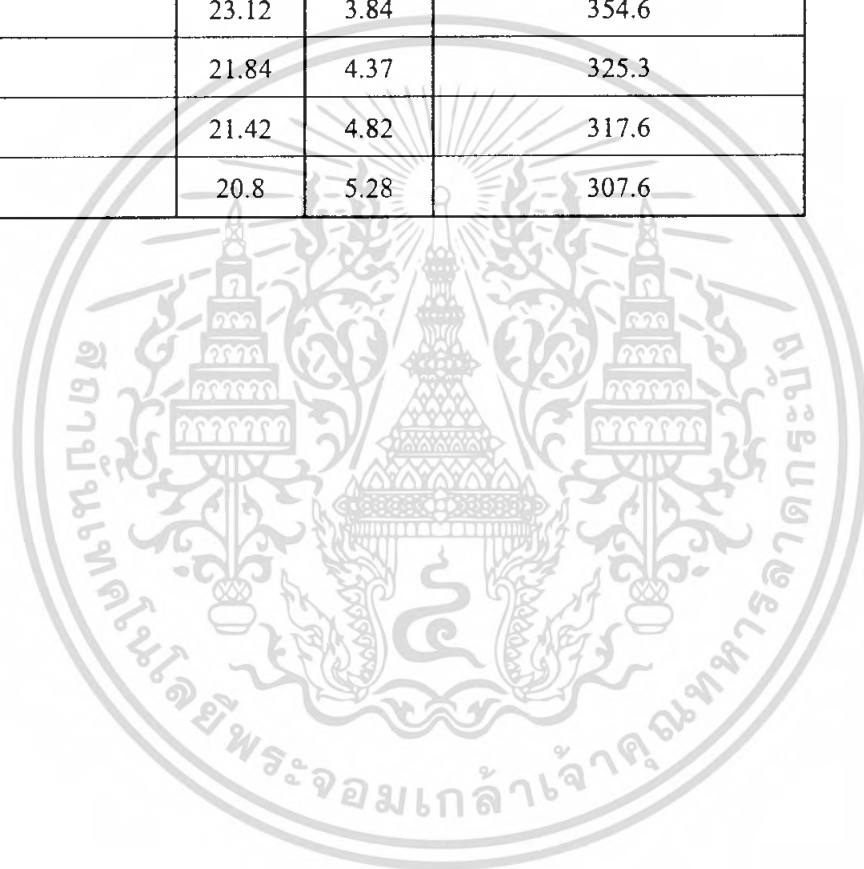

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

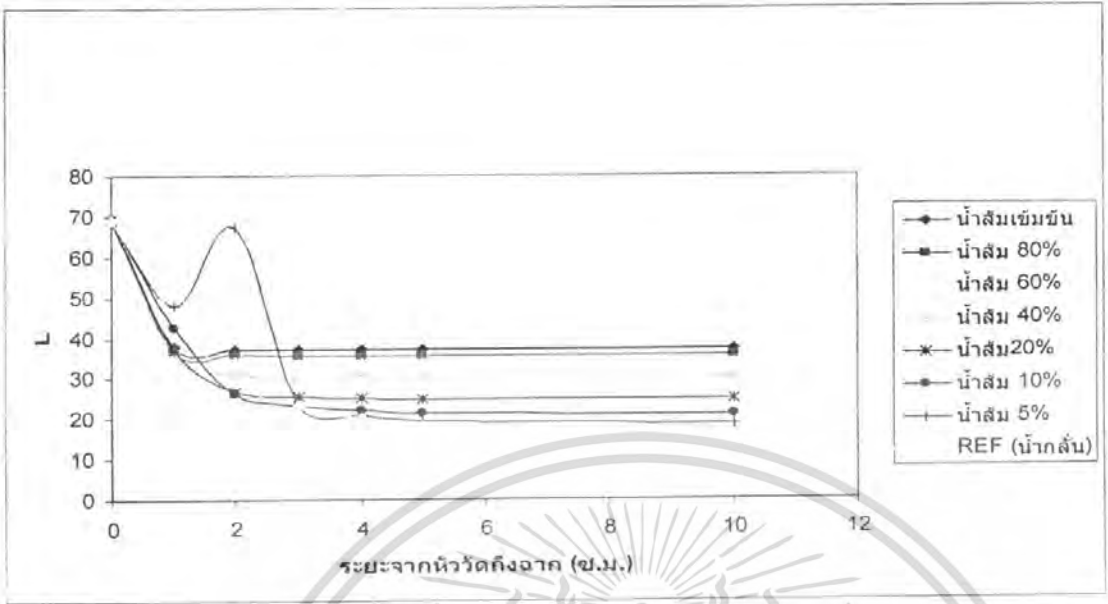


รูปที่ 4.19 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ L ของตัวอย่างน้ำส้ม ตรา โกลด์แพน ที่ทุกๆความเข้มข้น

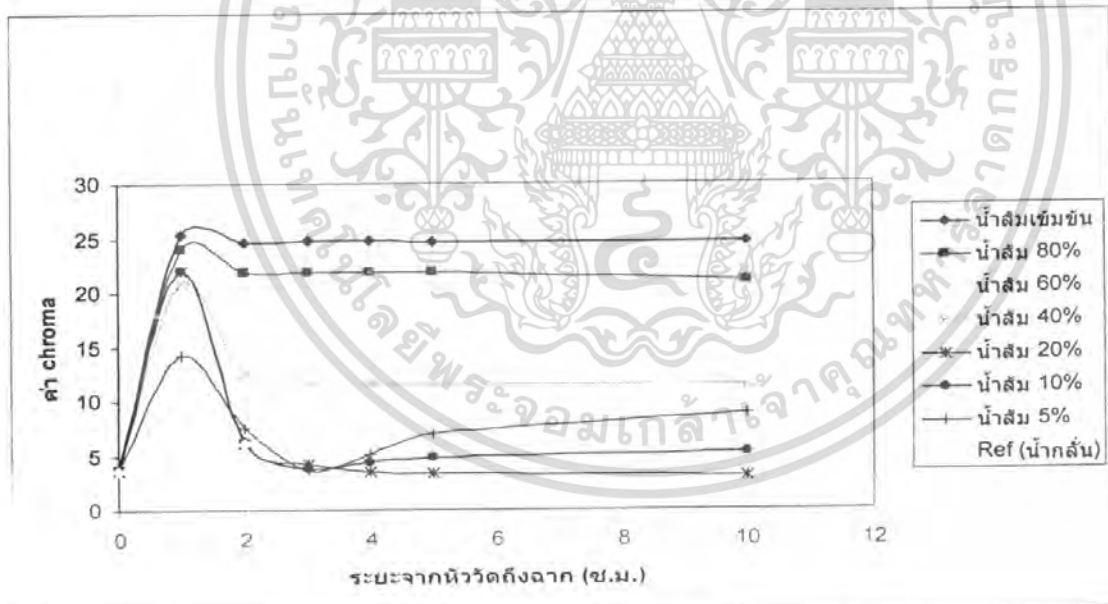

รูปที่ 4.20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ Chroma ของตัวอย่างน้ำส้ม ตรา โกลด์แพน ที่ทุกๆความเข้มข้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

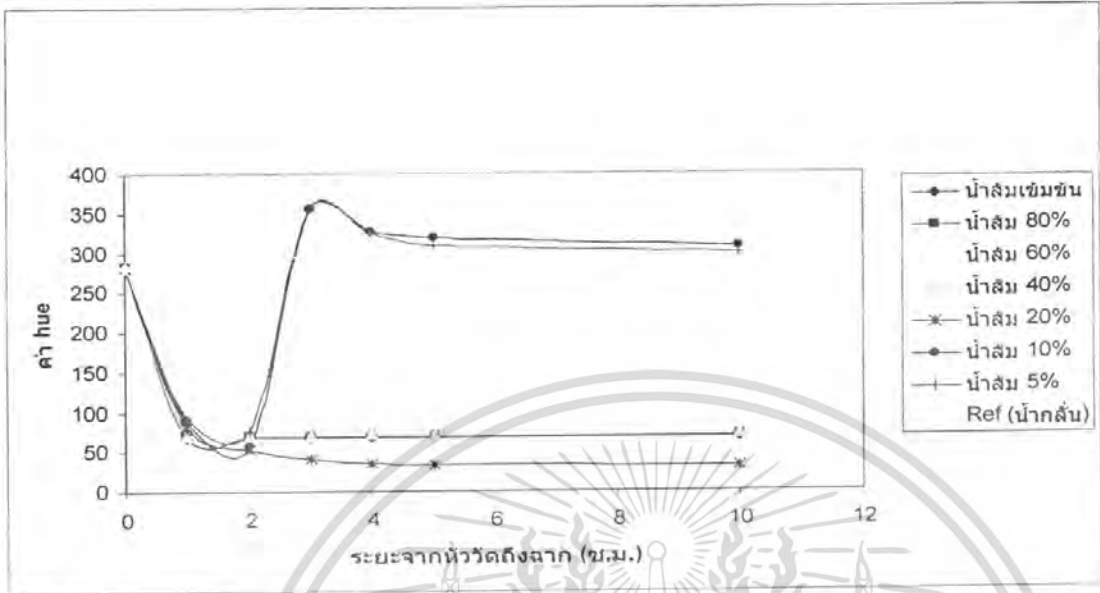

รูปที่ 4.21 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ Hue ของตัวอย่างน้ำส้ม ตราโกสต์แฟน ที่ทุกๆความเข้มข้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.4 ศึกษาปัจจัยระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉากที่ระยะ 0.2-1 เซนติเมตรและความเข้มข้นของน้ำแดงเฮลบลูบอยที่มีผลต่อการวัดสีอาหารเหลวโปร่งใส

จากรูปที่ 4.21 ,4.22 และ 4.23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า Chroma และค่า Hue กับระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉาก ที่ระยะ 0.2 เซนติเมตร ให้ค่า L ที่ชัดเจนและถูกต้องตามระดับความเข้มข้นของน้ำแดงเฮลบลูบอย โดยน้ำกลั่นจะมีค่า L สูงสุด รองลงมาเป็นน้ำแดงที่มีระดับความเข้มข้น 5% ,10%,20%,40%,60%,80% และ 100% ตามลำดับ เนื่องจากอาหารเหลวโปร่งใสที่มีความเข้มข้นน้อย จะมีระดับความเข้มของสีน้อย ทำให้มีค่าความสว่างมาก ส่วนที่ระยะหลัง 0.2 เซนติเมตรยังคงให้ค่าที่เป็นแนวโน้มถูกต้องแต่ไม่ชัดเจน ส่วนค่า Chroma ที่ระยะ 0.2 ให้ Chroma ถูกต้องและชัดเจนเช่นกันแต่หลังระยะ 0.2 เซนติเมตร ค่า Chroma เริ่มผิดไปจากความจริง โดยจะเห็นได้ชัดเจนว่าที่ระยะ 0.6 เซนติเมตร น้ำแดงเฮลบลูบอยที่มีความเข้มข้น 10 % มีค่า Chroma มากกว่าที่ความเข้มข้น 100% และเมื่อพิจารณาค่า Hue ตั้งแต่ระยะ 0.2 เซนติเมตร ให้ค่า Hue ที่คงที่ประมาณ 350 ซึ่งจะให้ค่าที่เป็นสีแดง ดังนั้นระยะที่เหมาะสม สำหรับการวัดสีอาหารเหลวโปร่งใสคือที่ระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่ 0.2 เซนติเมตร และระดับความเงาของอาหารเหลวโปร่งใสที่ยังคงให้ค่าที่ถูกต้องที่สุดคือที่ความเข้มข้น 40 % แต่ที่ระดับความเข้มข้นที่ต่ำกว่ายังสามารถวัดค่าสีได้แต่ค่าที่ได้ทั้งค่า L ค่า Chroma และค่า Hue นั้นจะเริ่มผิดไปจากความเป็นจริงเนื่องจากเมื่ออาหารเหลวโปร่งใสมีความเงามากจะทำให้การสะท้อนแสงของเครื่องวัดสี Minolta colorimeter CR 300 นั้นไม่สามารถสะท้อนค่าสีที่แท้จริงออกมาได้ แสงส่วนใหญ่จากเครื่องวัดสีจะสะท้อนผ่านอาหารเหลวไปสะท้อนกับฉาก ทำให้ค่าสีทั้งค่า L ค่า Chroma และค่า Hue นั้น เป็นค่าที่ได้จากการสะท้อนแสงจากฉากเป็นส่วนใหญ่

ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์บลูส์บอย ความเข้มข้น 100 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	34.16	51.83	375.3
0.6	25.53	47.2	376.9
1	19.66	29.73	351.3

ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์บลูส์บอย ความเข้มข้น 80 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	22.12	47.27	363.0
0.6	25.41	43.13	377.6
1	18.71	29.66	356.5

ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์บลูส์บอย ความเข้มข้น 60 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	39.78	48.21	367.6
0.6	25.45	44.72	378.9
1	18.77	28.89	357.5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์บลู๊บลอย ความเข้มข้น 40 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	45.05	41.44	363.4
0.6	28.76	46.28	380.8
1	20.44	31.36	363.4

ตารางที่ 4.30 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์บลู๊บลอย ความเข้มข้น 20 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	57.72	19.33	358.1
0.6	34.55	44.35	375.8
1	24.15	34.38	370.7

ตารางที่ 4.31 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลล์บลู๊บลอย ความเข้มข้น 10 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	54.13	21.73	362.2
0.6	37.47	31.38	368.1
1	27.59	32.97	370.2


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง คราเฮลต์บลู๊บล้อย ความเข้มข้น 5 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ


ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	58.33	21.73	362.2
0.6	30.78	25.45	365.6
1	30.78	25.45	365.6



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

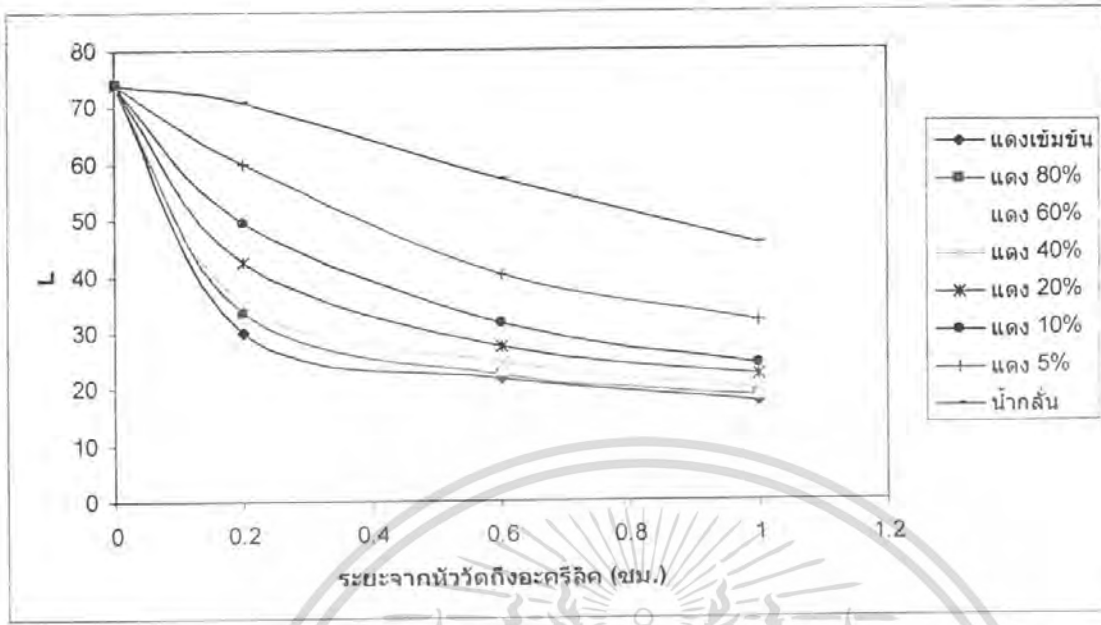


รูปที่ 4.22 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ L ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลบลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น

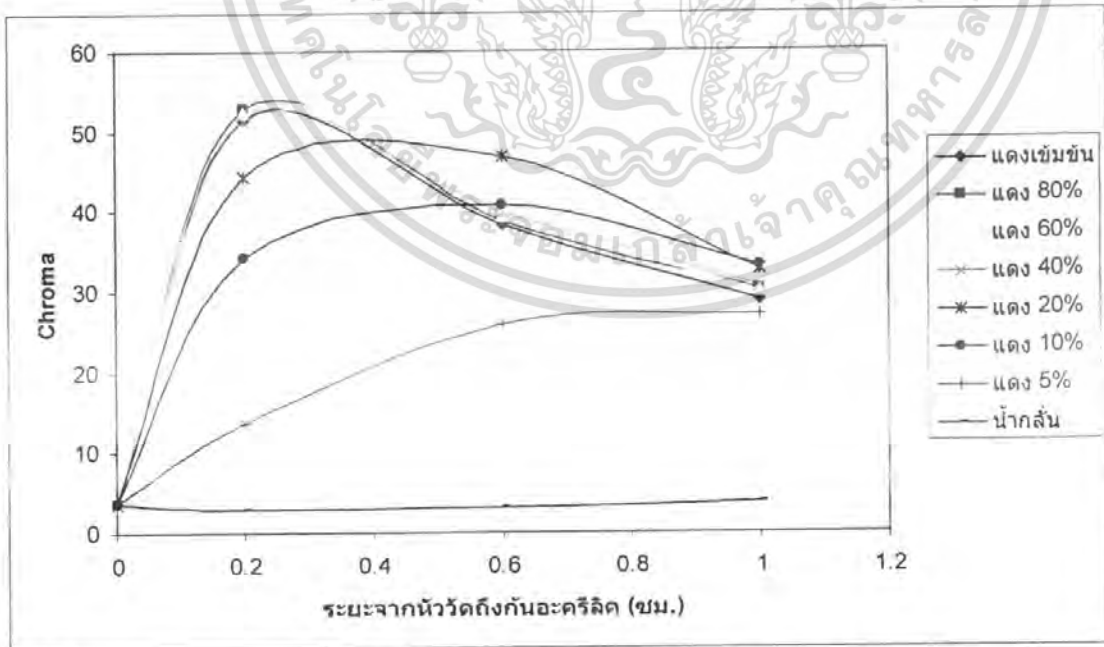

รูปที่ 4.23 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ Chroma ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลบลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

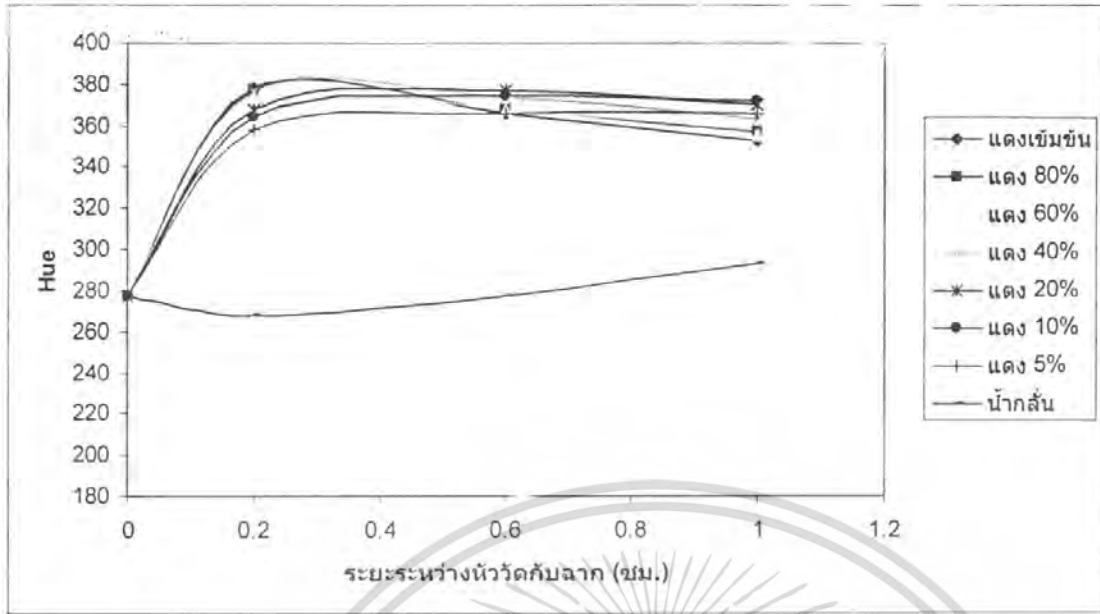

รูปที่ 4.24 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ Hue ของตัวอย่างน้ำแดง ตราเฮลบลูบอยที่ทุกๆ ความเข้มข้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บล้อย ความเข้มข้น 100 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	50.62	58.06	138.7
0.6	32.19	45.41	153.3
1	23.21	16.67	178.9

ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บล้อย ความเข้มข้น 80 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	57.54	57.88	133.1
0.6	34.95	49.48	150.8
1	29.43	35.41	159.4

ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บลู๊บล้อย ความเข้มข้น 60 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	55.78	57.19	134
0.6	36.39	49.07	148.7
1	30.2	35.87	157.5

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บรู๊ตบอย ความเข้มข้น 40 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hueเฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	57.12	49.31	132.8
0.6	44.24	54.13	142.1
1	33.43	37.45	157.5

ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บรู๊ตบอย ความเข้มข้น 20 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hueเฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	64.19	27.02	131.6
0.6	48.87	45.05	137
1	37.59	34.33	144.1

ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลล์บรู๊ตบอย ความเข้มข้น 10 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	64.49	18.05	132.4
0.6	46.12	35.66	135.1
1	42.24	27	137.2


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L*, Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเฮลต์บลูส์บอย ความเข้มข้น 5 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉากต่างๆ


ระยะจากหัววัดถึงฉาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	61.77	17.84	132.5
0.6	50.73	26.49	132.8
1	44.76	17.04	136.5



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

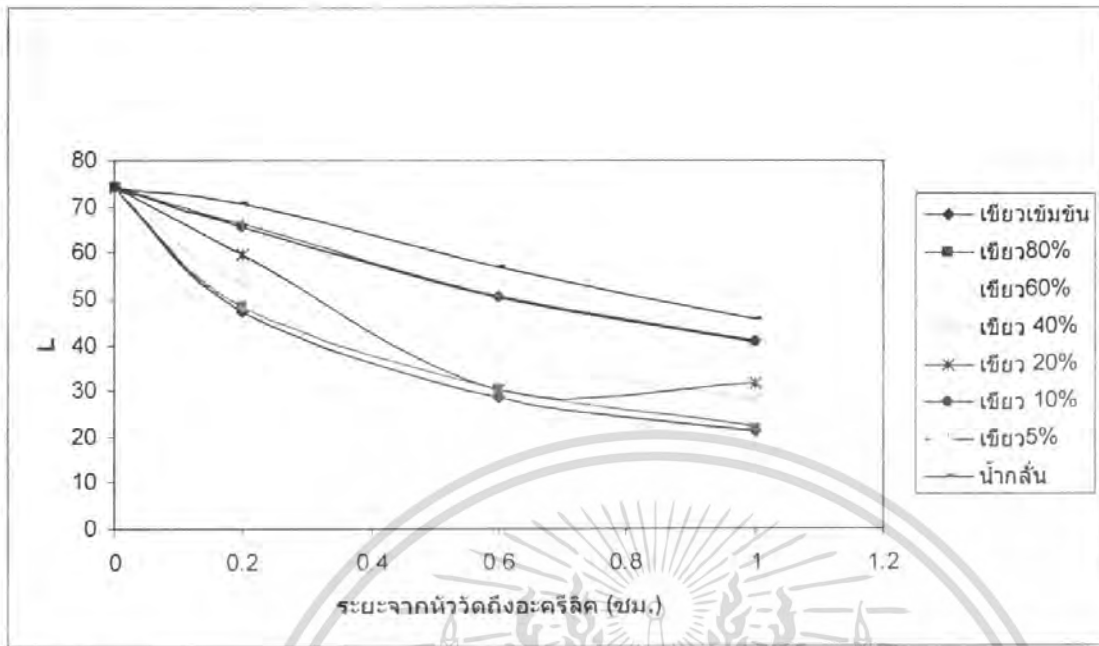


รูปที่ 4.25 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยของ L ของตัวอย่างน้ำเชียว ตราเฮลบลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น

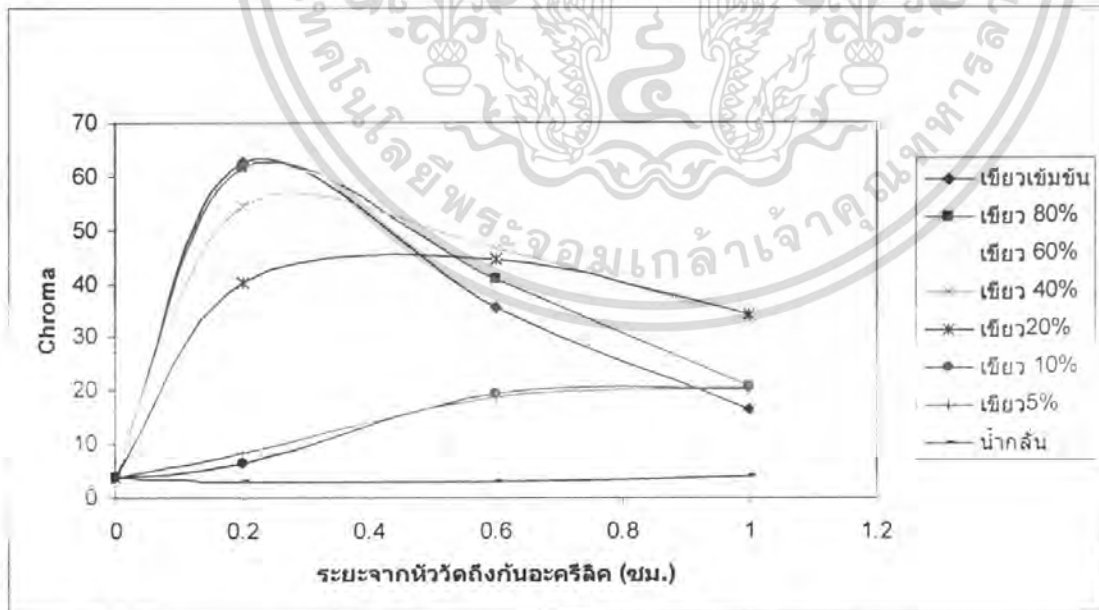

รูปที่ 4.26 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ย Chroma ของตัวอย่างน้ำเชียว ตราเฮลบลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

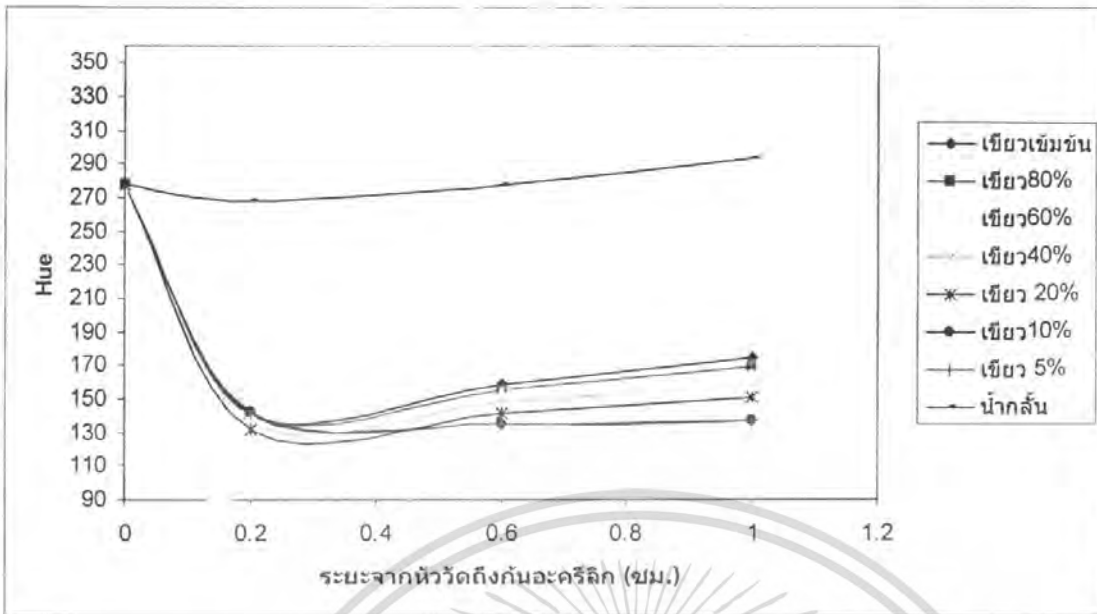

รูปที่ 4.27 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงกึ่งกลางกับค่าเฉลี่ยChroma ของตัวอย่างน้ำเขียว ตราเสลบลูบอยที่ทุกๆความเข้มข้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 100 % ที่ระยะจากหัววัดถึงฉลากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉลาก (เซนติเมตร)	Lเฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	51.91	50.21	77.6
0.6	41.27	33.75	68
1	39.84	31.19	67.5

ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 80% ที่ระยะจากหัววัดถึงฉลากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉลาก (เซนติเมตร)	Lเฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	52.07	49.38	79.7
0.6	41.06	32.69	70.1
1	36.91	25.42	67.7

ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 60% ที่ระยะจากหัววัดถึงฉลากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉลาก (เซนติเมตร)	Lเฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	54.18	49.12	83.8
0.6	41.68	33.05	73.6
1	36.02	23.53	69.3

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 40% ที่ระยะจากหัววัดถึงฉลากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉลาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	62.29	34.85	91.1
0.6	44.82	36.81	80.4
1	62.29	34.85	91.1

ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 20% ที่ระยะจากหัววัดถึงฉลากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉลาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	65.33	19.27	94.9
0.6	48.53	34.86	87.7
1	36.61	23.35	79.5

ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 10% ที่ระยะจากหัววัดถึงฉลากต่างๆ

ระยะจากหัววัดถึงฉลาก (เซนติเมตร)	L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	66.94	9.5	97.9
0.6	53.35	23.69	93
1	37.99	21.3	86


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L , Chroma และ Hue ของตัวอย่างน้ำส้มตราโกสแพน ความเข้มข้น 5% ที่ระยะจากหัววัดถึงฉลากต่างๆ


ระยะจากหัววัดถึงฉลาก (เซนติเมตร)	Chroma		
	L เฉลี่ย	เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0	74	3.58	277.1
0.2	64.78	6.06	98.4
0.6	53.24	13.3	95.6
1	40.4	15.1	90.9



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

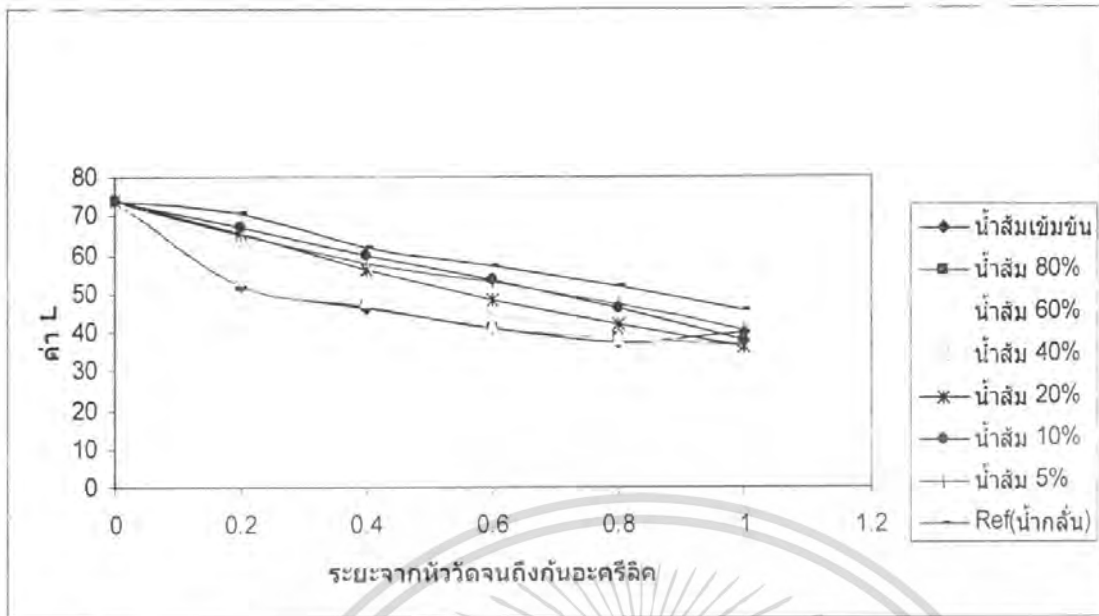


รูปที่ 4.28 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงจากกับค่าเฉลี่ย L ของตัวอย่างน้ำส้ม ตรา โกลแพนที่ทุกๆความเข้มข้น

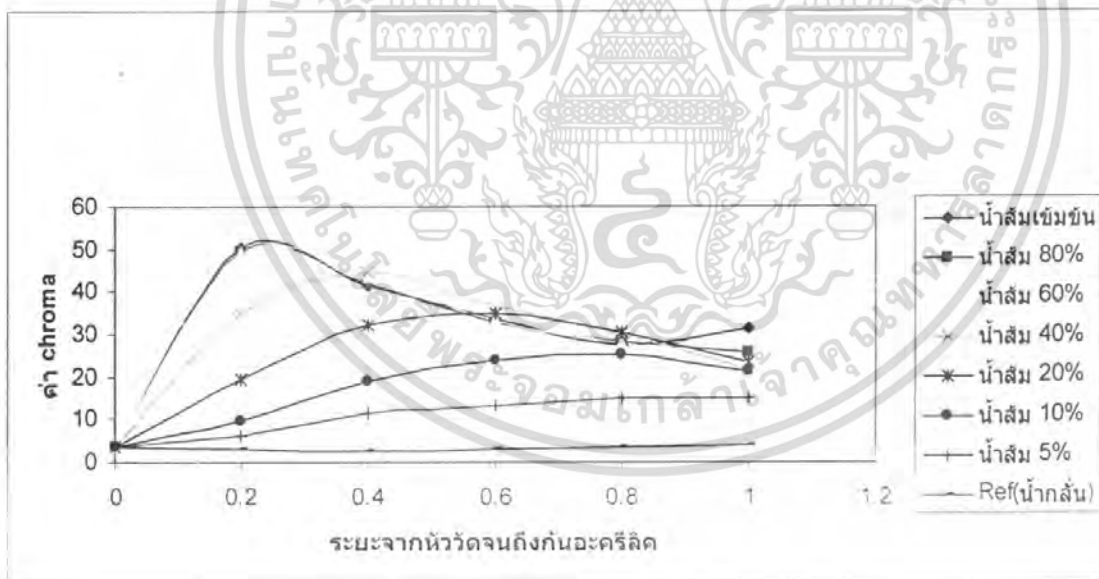

รูปที่ 4.29 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงจากกับค่าเฉลี่ย Chroma ของตัวอย่างน้ำส้ม ตรา โกลแพนที่ทุกๆความเข้มข้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

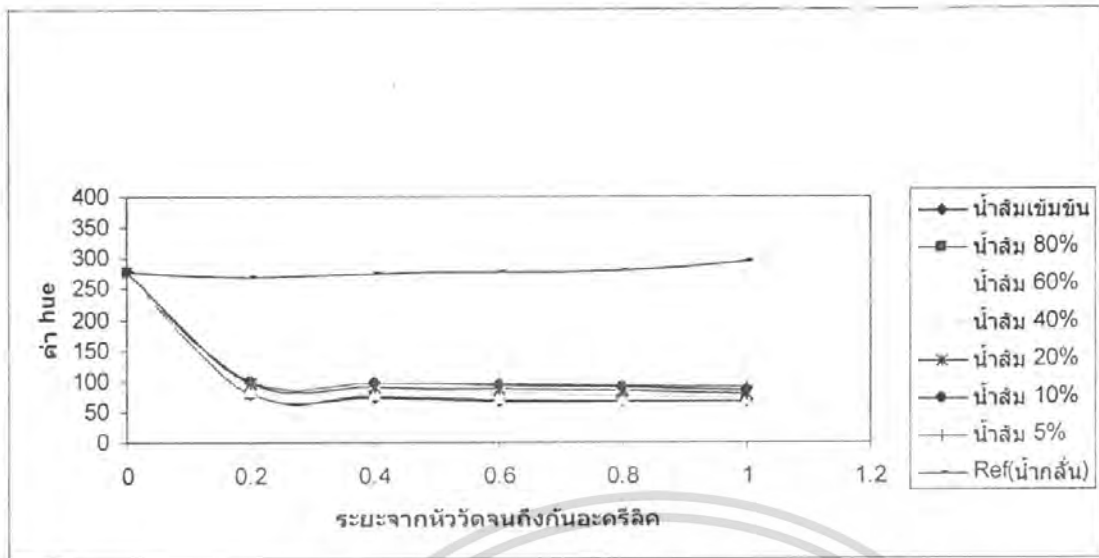

รูปที่ 4.30 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยHue ของตัวอย่างน้ำส้ม ตรา โกลสเพนที่ทุกๆความเข้มข้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

4.5 การออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใส

จากการศึกษาปัจจัยพื้นที่หน้าตัด สีของฉาก ระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉาก และระดับความเข้มข้นของอาหารเหลวโปร่งใส พบว่า พื้นที่หน้าตัดไม่มีผลต่อค่าสี ระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉากที่ดีที่สุดคือ 0.2 เซนติเมตร และระดับความเข้มข้นที่ยังคงให้ค่าสีที่ถูกต้องคือ 40% ดังนั้นภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใสที่ได้จึงเลือกใช้กระเบื้องแทนพลาสติกสีขาวเนื่องจากพลาสติกสีขาวนั้นเมื่อเป็นระยะเวลานานจะทำให้สีของพลาสติกเปลี่ยนแปลงไป ค่า L ค่า Chroma และค่า Hue ของพลาสติกที่เปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไปนั้น จะทำให้ค่า L ค่า Chroma และค่า Hue ของอาหารเหลวโปร่งใสเปลี่ยนไปด้วย นอกจากนี้การใช้พลาสติกยังทำความสะอาดได้ยาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายถ้าจะต้องเปลี่ยนพลาสติกที่ใช้บ่อยๆ ดังนั้นกระเบื้องจึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุด สีของกระเบื้องจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ส่วนขนาดของภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใส นั้นจะมีขนาดเท่ากับ ขนาดของแผ่นกระเบื้องเนื่องจากไม่มีอิทธิพลของขนาดพื้นที่หน้าตัด ส่วนระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉากจะเท่ากับ 0.2 เซนติเมตร ซึ่งเป็นค่าที่น้อยมาก ในการทำการทดลองอาจเกิดความผิดพลาดจากผู้ทดลอง ที่อาจวัดสีเกินระยะ 0.2 เซนติเมตร หรืออาจวัดไม่ถึงที่ระยะ 0.2 เซนติเมตร และ การใช้เครื่องวัดสี Minolta Colorimeter CR 300 นั้นจะต้องป้องกันไม่ให้อาหารเหลว ไปสัมผัสกับตัวเซ็นเซอร์ซึ่งจะทำให้เครื่องเสียได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันเครื่องเสียหายและรักษาระยะการวัดที่ 0.2 เซนติเมตร จึงได้ออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใสที่ทำการวัดในแนวนอน ผ่านอะคริลิกที่มีความหนาของอะคริลิกที่ 0.2 มิลลิเมตร

4.6 เปรียบเทียบค่า L, Chroma, Hue ที่ทำการวัดโดยสัมผัสของเหลวโดยตรงกับการวัดผ่านอะคริลิก

จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการวัดโดยสัมผัสของเหลวโดยตรงกับการวัดผ่านอะคริลิก พบว่าการวัดผ่านอะคริลิกให้ผลเป็นไปในแนวโน้มนี้อยู่ร่วมกันกับการวัดด้วยการสัมผัสกับของเหลวโดยตรง จากกราฟที่ 4.30 จะเห็นว่าค่า L ยังคงให้ค่ามากเมื่ออาหารเหลวโปร่งใสมีความเจือจางมากขึ้นทั้งน้ำแดง น้ำเขียวตราเฮลบลูบอย และน้ำส้มตราโกสแพน ส่วนค่า Chroma เป็นค่าที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ของสี ดังนั้นเมื่ออาหารเหลวโปร่งใสมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น ค่า Chroma ก็ จะมากขึ้นด้วย ดังกราฟที่ 4.31 และเมื่อพิจารณากราฟ 4.32 ค่า Hue ซึ่งเป็นค่าสีของอาหารเหลว โปร่งใสที่ใช้ในการวัด ดังนั้นความเข้มข้นจึงไม่มีผลต่อค่า Hue นั่นคือทุกระดับความเข้มข้นของ อาหารเหลวโปร่งใสแต่ละสีจะยังคงให้ค่าที่เป็นสีนั้นเท่ากันทุกระดับความเข้มข้น ดังกราฟที่ 4.32 จะ เห็นว่าที่น้ำแดงตราเฮลบลูบอยที่วัดโดยการสัมผัสของเหลวและวัดผ่านอะคริลิกนั้นมีค่า Hue ที่ 370 ในทุกระดับความเข้มข้น น้ำเขียวตราเฮลบลูบอยที่วัดโดยการสัมผัสของเหลวและวัดผ่านอะคริลิก นั้นมีค่า Hue ที่ 125 ในทุกระดับความเข้มข้น และน้ำส้มตราโกสแพนที่วัดโดยการสัมผัสของเหลว และวัดผ่านอะคริลิกนั้นก็ให้ค่า Hue ที่ 60-70 ในทุกระดับความเข้มข้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นการบรรจุ อาหารเหลวโปร่งใสลงในภาชนะบรรจุที่ออกแบบมาดังกล่าวแล้วมาทำการวัดด้วยการวัดผ่าน อะคริลิกก็ให้ค่า L ค่า Chroma และค่า Hue ที่ถูกต้อง

ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า Chroma และค่า Hue ของน้ำแดง ตราเฮลบลูบอย วัดโดย การวัดผ่านอะคริลิก ระยะ 0.2 เซนติเมตร ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

ระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉาก(ซม.)	ความเข้มข้น(%)	น้ำแดงตราเฮลบลูบอย		
		L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0.2	100%	31.87	15.19	356.1
	80%	33.39	15.35	362
	60%	33.85	14.81	362.5
	40%	34.05	16.67	365.77
	20%	35.68	18.95	370.77
	10%	37.09	19.74	371.6
	5%	37.51	19.83	370.9
	น้ำกลั่น	70.76	2.88	267.8


ตารางที่ 4.48 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า Chroma และค่า Hue ของน้ำเขียว ตราเฮลบลูบอย วัดโดย การวัดผ่านอะคริลิก ระยะ 0.2 เซนติเมตร ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ

ระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉาก(ซม.)	ความเข้มข้น(%)	น้ำแดงตราเฮลบลูบอย		
		L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0.2	100%	32.25	10.55	162.6
	80%	34.07	14.39	159.07
	60%	37.07	16.94	158.33
	40%	38.26	18.57	156.03
	20%	41.6	22.26	148.9
	10%	44.5	21.3	142.53
	5%	46.16	18.9	139
	น้ำกลั่น	70.76	2.88	267.8


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ตารางที่ 4.49 แสดงค่าเฉลี่ยของค่า L ค่า Chroma และค่า Hue ของน้ำส้ม ตราโกสแพน วัดโดยการวัดผ่านอะคริลิก ระยะ 0.2 เซนติเมตร ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ


ระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉาก(ซม.)	ความเข้มข้น(%)	น้ำแดงตราเฮลบลูบอย		
		L เฉลี่ย	Chroma เฉลี่ย	Hue เฉลี่ย
0.2	100%	41.38	13.87	56
	80%	40.26	15.77	64.5
	60%	39.88	14.7	66
	40%	39.74	14.23	68.8
	20%	41.46	16.49	78.7
	10%	44.36	17.79	88.3
	5%	46.59	12.86	92.9
	น้ำกลั่น	70.76	2.88	267.8

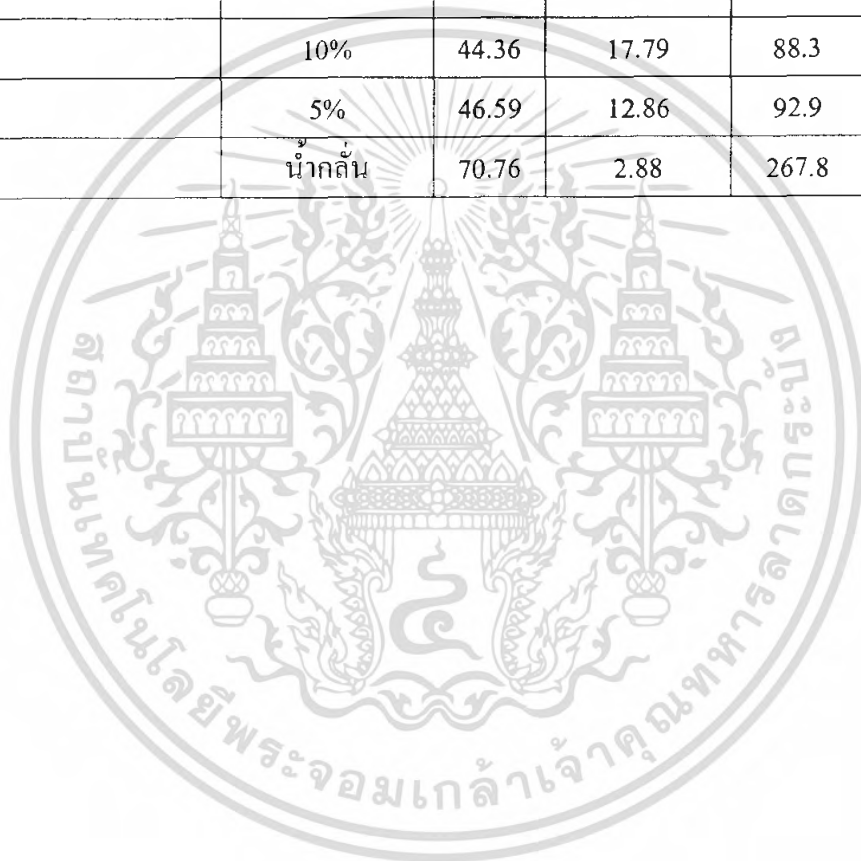

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

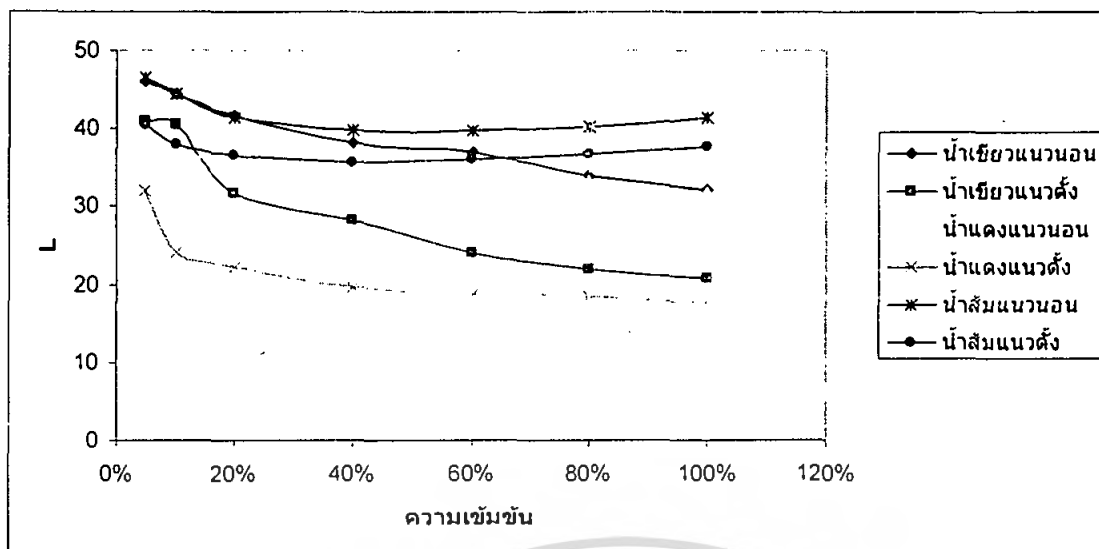


รูปที่ 4.31 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ย L ของตัวอย่าง โดย การวัดผ่านอะคริลิก

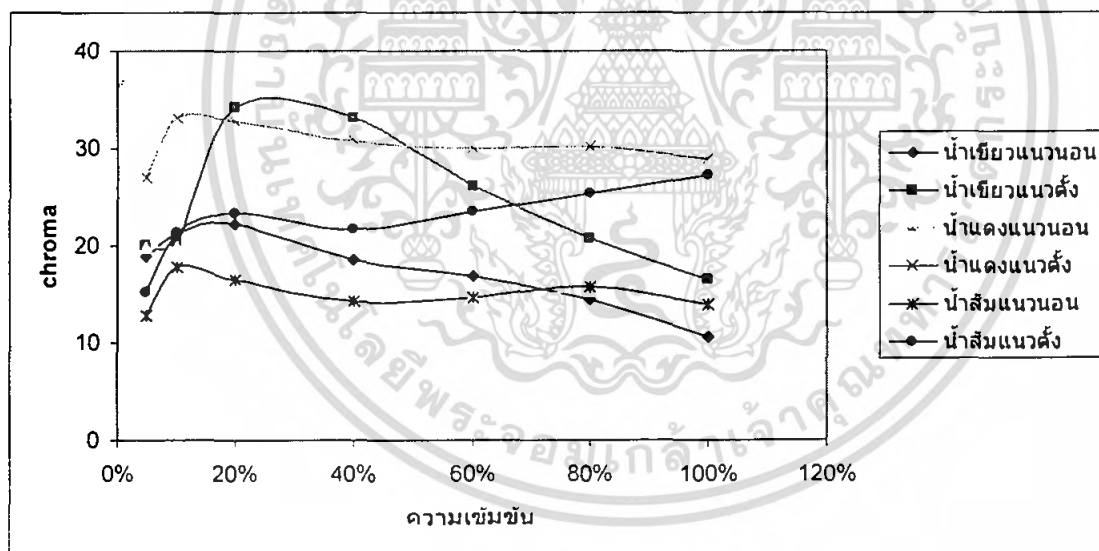

รูปที่ 4.32 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ย Chroma ของตัวอย่าง โดย การวัดผ่านอะคริลิก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

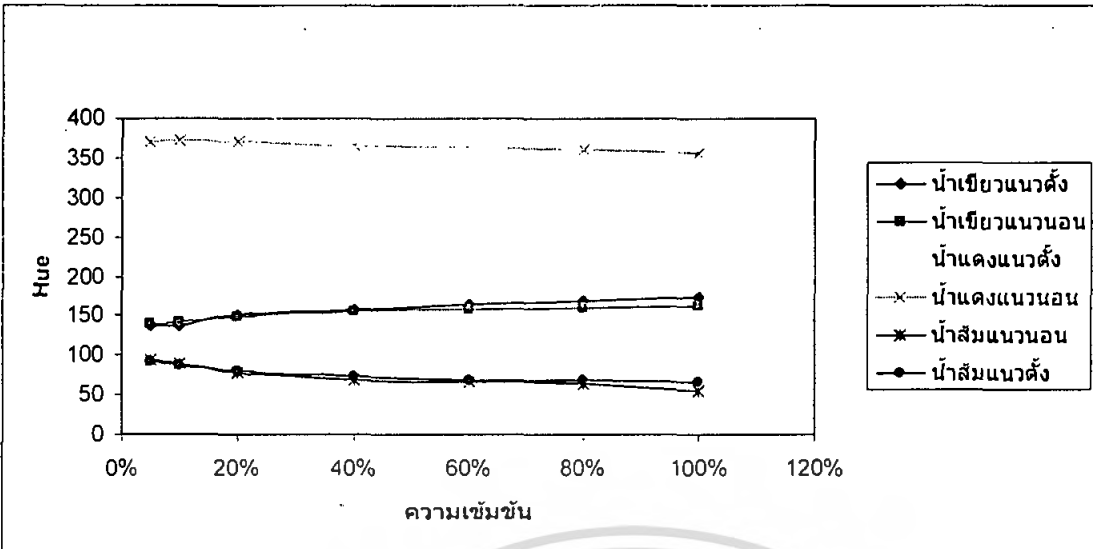

รูปที่ 4.33 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจากหัววัดถึงฉากกับค่าเฉลี่ยHue ของตัวอย่าง โดยการวัดผ่านอะคริลิก



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บรรณานุกรม

- Billmeyer, F. W., Jr. and Saltzman, M. 1981. **Principles of Color Technology**, New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Cayless, M.A. and Marsden, A.M. 1983. **Lamp and Lighting**. 3 rd.ed., Arnold, London.
- D. Ansorna, M. P. De Pena, I. Astiasaran and J. Belle. 1997. **Colour Evaluation : Comparison Between the CIE L* a* b* and the Hunter Lab system with Illuminants D65 and C. Meat Science.**
- Hunter, R. S., and Harold, R. W. ,1987. **The measurement of Appearance**. John Wiley Pub., New York .
- Hunt, R.W.G. 1993. **Measuring Colour**. 2 nd.ed., The City University, London.
- J. E. Hutching. 1995. **Food Color and Appearance**. Colmworth, Bedford, UK.
- Little A C, Chichester C O, MacKinney G. 1985. **On Clor Measurement in foods**. Food Tech.
- Little Angela C. 1964 . **Color Measurement of translucent food samples**. J Food Sci 29.
- ชลธิชา ธนจิตพิงศ์ และ วิกานดา วงศ์รินทรเมธี. 2549. **การวัดสีของอาหารเหลวชนิดโปร่งใสและโปร่งแสงด้วยเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง (Color Measurement of Transparent and Translucent Liquid Food Using Reflection Colorimeter)** สาขาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร โครงการคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- พวงร้อย. 2544. <http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php? Cid=102&Pid=10373&ooc=3>
- ผู้แต่งไม่ระบุ .1996. **Hunter L a b color scale** ,http://www.hunterlab.com/appnotes/an08_96a.pdf
- ผู้แต่งไม่ระบุ .1948. **Lab color space** ,http://en.wikipedia.org/wiki/Lab_color_space

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก ก

วิธีการใช้และทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใสเพื่อวัดสีด้วยเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง(Minolta CR-300,Japan)

วิธีการใช้มีดังต่อไปนี้

1. ใส่กระเบื้องสีขาว(L= 90.6 ,chroma= 3.21 ,hue=88.4)ลงในช่องใส่กระเบื้องที่ได้ออกแบบไว้เพื่อใช้ทำเป็นฉาก
2. บรรจุตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใสที่ต้องการทราบค่าสี(L, chroma,hue)ลงในช่องสำหรับใส่ตัวอย่างจนเต็ม ซึ่งอยู่ด้านหน้าของกระเบื้องสีใช้ทำเป็นฉาก
หมายเหตุ ระดับความเข้มข้นของตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใสที่ใช้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งาน
3. ทำการวัดค่าสีโดยนำหัววัดของเครื่องวัดสีแบบสะท้อนแสง วางติดในแนวระนาบจับผิวสัมผัสกับภาชนะ
4. กดปุ่มวัดสี
5. บันทึกผลค่า L ค่าchroma และค่า hue โดยการวัด 3 ครั้งและหาค่าเฉลี่ย
6. ในกรณีที่ตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใสมีมากกว่า 1 ชนิด และมีระดับความเข้มข้นหลายระดับ ให้ทำการทดลองซ้ำโดยเปลี่ยนตั้งตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใสและระดับความเข้มข้นจนครบ

วิธีการทำความสะอาด

1. นำกระเบื้องออกจากช่องสำหรับใส่กระเบื้อง แล้วทำความสะอาดด้วยแปรงที่จุ่มน้ำยาทำความสะอาด เพื่อขจัดคราบสีที่ติดอยู่กับผิวกระเบื้อง
2. ใช้แปรงจุ่มน้ำยาทำความสะอาด ทำความสะอาดบริเวณช่องที่ใช้บรรจุกระเบื้องและตัวอย่างอาหารเหลวโปร่งใส
3. ล้างด้วยน้ำสะอาด
4. เช็ดและผึ่งให้แห้ง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

5.1 จากผลการศึกษาปัจจัยพื้นที่หน้าตัด ที่คาดว่าจะมีผลต่อการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส พบว่าทุกขนาดของพื้นที่หน้าตัด คือ 10X10 ตารางเซนติเมตร 12X12 ตารางเซนติเมตร 14X14 ตารางเซนติเมตรและ 16X16 ตารางเซนติเมตร ให้ผลของค่าเฉลี่ยของ L , Chroma และ Hue ที่ได้ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซนต์ แสดงว่า ทุกขนาดพื้นที่หน้าตัด ไม่มีผลต่อค่าสีเฉลี่ยของอาหารเหลวโปร่งใสที่วัดได้ ดังนั้นในการวัดสีสามารถใช้ขนาดพื้นที่หน้าตัดได้ทุกขนาด แต่ทั้งนี้ควรคำนึงถึงปริมาณของตัวอย่างที่จะนำมาใช้เพื่อเป็นการประหยัดตัวอย่าง

5.2 จากผลการศึกษาปัจจัยสีของฉลาก ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส พบว่า ฉากสีดำนั้นมีผลต่อการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใสนี้ทั้งสามตัวอย่าง ได้แก่ น้ำแดง ตราเฮลล์บลูบอย น้ำเขียว ตราเฮลล์บลูบอย และน้ำส้ม ตราโกลด์แพน ซึ่งทำให้ผลของสี L , Chroma และ Hue ที่ได้ผิดเพี้ยนไป ทั้งแบบที่นำฉากสีดำนี้ติดโดยรอบกล่องอะคริลิกและแบบที่ติดตรงกันอะคริลิก แต่สำหรับฉากสีขาวทั้งการติดสองแบบที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น พบว่า ให้ผลเฉลี่ยของค่าการวัดสี L , Chroma และ Hue ที่ถูกต้องตามลักษณะสีที่ปรากฏของตัวอย่างทั้งสาม และการติดฉากสีขาวทั้งสองลักษณะให้ผลที่มีแนวโน้มเดียวกัน ดังนั้นในการเลือกสีฉากมาใช้ นั้น ควรเป็นฉากสีขาว เนื่องจากสีขาวนั้นทำให้เกิดการสะท้อนของเครื่องได้ดี จึงให้ผลของค่าสีทั้ง L, Chroma และ Hue เป็นไปตามสีที่ปรากฏมาสู่สายตาของผู้ทดสอบ สำหรับลักษณะการติดฉากนั้นสามารถใช้ได้ทั้งสองลักษณะ ไม่ว่าจะใช้ฉากสีขาวติดที่กันอะคริลิกหรือติดโดยรอบอะคริลิกนั้น ไม่มีผลต่อผลเฉลี่ยของค่าสีทั้งสาม

5.3 จากผลการศึกษาปัจจัยของระยะจากหัววัดจนถึงฉากช่วง 1 – 10 เซนติเมตร ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส พบว่าระยะที่ใกล้ฉากมากที่สุด จะให้ผลเฉลี่ยของค่าสี L , Chroma และ Hue ได้ถูกต้องที่สุด และมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้น ความเข้มข้นของตัวอย่างมาก จะให้สีที่มีจุดสีเข้มและชัดกว่าตัวอย่างที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า เมื่อเราใช้ระยะจากหัววัดถึงฉากมากเท่าไร ค่าเฉลี่ยของค่าสีที่ได้ยิ่งผิดเพี้ยนไป โดยเฉพาะตัวอย่างที่มีความเข้มข้นต่ำมาก ค่าสีที่ได้จะแตกต่างจากสีที่ปรากฏออกมาโดยสิ้นเชิง ดังนั้นระยะที่ใช้ได้ดี ให้ผลของค่าสีถูกต้องตามสีที่ปรากฏออกมา คือ 1 เซนติเมตร นั่นเอง

5.4 จากผลการศึกษาปัจจัยระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉากที่ระยะ 0.2-1 เซนติเมตร ที่คาดว่าจะมีผลต่อค่าการวัดสีของอาหารเหลวโปร่งใส จากการทดลองข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าระยะที่ใกล้ฉากมากที่สุดจะให้ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด ดังนั้นผู้ทดลองจึงทำการหาระยะที่ใกล้ฉาก

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

มากยิ่งขึ้น นั่นคือระยะที่ 0.2-1 เซนติเมตร พบว่าระยะระหว่างหัววัดกับฉากที่ 0.2 เซนติเมตร และระดับความเงาของอาหารเหลวโปร่งใสที่ยังคงให้ค่าที่ถูกต้องที่สุดคือที่ความเข้มข้น 40 % แต่ที่ระดับความเข้มข้นที่ต่ำกว่ายังสามารถวัดค่าสีได้แต่ค่าที่ได้ทั้งค่า L ค่า Chroma และค่า Hue นั้นจะเริ่มผิดไปสี่ที่ปรากฏสู่สายตาเรา เนื่องจากเมื่ออาหารเหลวโปร่งใสมีความเงามากจะทำให้การสะท้อนแสงของเครื่องวัดสี Minalta colorimeter CR 300 นั้นไม่สามารถสะท้อนค่าสีที่แท้จริงออกมาได้ แสงส่วนใหญ่จากเครื่องวัดสีจะสะท้อนผ่านอาหารเหลวไปสะท้อนกับฉาก ทำให้ค่าสีทั้งค่า L ค่า Chroma และค่า Hue นั้น เป็นค่าที่ได้จากการสะท้อนแสงจากฉากเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นระยะที่ ดังนั้นระยะที่ให้ผลการวัดที่ดีที่สุดคือ ที่ 0.2 เซนติเมตร และความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่สามารถวัดที่ระยะนี้ถูกต้องที่สุดคือ ที่ความเข้มข้น 40% นั่นเอง

5.5 จากการศึกษาปัจจัยพื้นที่หน้าตัด สีของฉาก ระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉาก และระดับความเข้มข้นของอาหารเหลวโปร่งใส พบว่า พื้นที่หน้าตัด ไม่มีผลต่อค่าสี ระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉากที่ดีที่สุดคือ 0.2 เซนติเมตร ซึ่งมีฉากสีขาว ช่วยในการสะท้อนแสงของตัวเครื่องมือที่ใช้วัด และระดับความเข้มข้นที่ยังคงให้ค่าสีที่ถูกต้องคือ 40% ดังนั้นภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใสที่ได้จึงเลือกใช้กระเบื้องแทนพลาสติกสีขาวเนื่องจากพลาสติกสีขาวนั้นเมื่อเป็นระยะเวลานานจะทำให้สีของพลาสติกเปลี่ยนแปลงไป ค่า L ค่า Chroma และค่า Hue ของพลาสติกที่เปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไปนั้น จะทำให้ค่า L ค่า Chroma และค่า Hue ของอาหารเหลวโปร่งใสเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นกระเบื้องจึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุด

สีของกระเบื้องจะไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ส่วนขนาดของภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใส นั้นจะมีขนาดเท่ากับ ขนาดของแผ่นกระเบื้องเนื่องจากไม่มีอิทธิพลของขนาดพื้นที่หน้าตัด ส่วนระยะห่างระหว่างหัววัดกับฉากจะเท่ากับ 0.2 เซนติเมตร ซึ่งเป็นระยะที่น้อยมาก ในการทำการทดลองอาจเกิดความผิดพลาดจากผู้ทดลอง ที่อาจวัดลึกเกินระยะ 0.2 เซนติเมตร หรืออาจวัดไม่ถึงที่ระยะ 0.2 เซนติเมตรและการใช้เครื่องวัดสี Minalta Colorimeter CR 300 นั้นจะต้องป้องกันไม่ให้อาหารเหลวไปสัมผัสกับตัวเซ็นเซอร์ซึ่งจะทำให้เครื่องเสียได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันเครื่องเสียหายและรักษาระยะการวัดที่ 0.2 เซนติเมตร จึงได้ออกแบบภาชนะบรรจุอาหารเหลวโปร่งใสที่ทำการวัดในแนวนอน ผ่านอะคริลิกที่มีความหนาของอะคริลิกที่ 0.2 มิลลิเมตร ผลที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการวัด โดยให้หัววัดสัมผัสกับของเหลวโปร่งใสแล้ว พบว่าให้ผลที่ใกล้เคียงกันมาก ไม่มีความแตกต่างที่ทำให้ผลคลาดเคลื่อน ดังนั้นในการวัดสีนี้ควรเลือกใช้การวัดที่วัดผ่านอะคริลิกหนา 0.2 มิลลิเมตร โดยให้มีช่องขนาด 0.2 เซนติเมตร เพื่อใส่ตัวอย่าง ระยะนี้เปรียบได้กับระยะจากหัววัดถึงฉากของวิธีวัด โดยให้หัววัดสัมผัสกับตัวอย่าง ส่วนฉากที่ใช้จะเป็นกระเบื้องสีขาวที่มีค่า $L = 90.6$, $Chroma = 3.21$, และ $Hue = 88.4$ ดังภาคผนวก ก